



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

DOKUMENTAT STANDARDE
TË PROCEDURËS SË HAPUR
MALLRA ¹

OBJEKTI I PROKURIMIT: “F.V pajisje hotelerie dhe mjekesore per maternitetin e Beratit”.

FONDI LIMIT NE TOTAL: 59 464 949

(pesedhjeteeentemilione katerqindegjashtedhjetee katermijeenenteqindedyzeteenente) leke pa TVSH.

Loti 1: “F.V paisje mjekesore për Maternitetin e Beratit ”, me fond limit: 50 212 610
(pesedhjetemilionedyqindedybedhjetemijeegjashteqindedhjetete) leke pa TVSH.

Loti 2: “F.V pajisje hotelerie për Maternitetin e Beratit ”, me fond limit: : 9 252 339
(nentemilionedyqindepesedhjeteedymijeetreqindeetridhjeteeente) leke pa TVSH.

¹

Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Rajonal Berat/Armelin Çili
 Adresa Lagjia Kushtrim Berat
 Tele/fax 0035/32-34 237/0694598444
 E-mail spitaliberat@shendetesia.gov.al/armelin73@gmail.com
 Faqja e Internetit _____

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qendror	Institucion i pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njesi e qeverisjes vendore	Tjetër
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po Jo

Seksioni 2. Objekti i kontratës

1. 2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit: NR REF-84998-01-27-2021

1	Loti 1-F.V paisje Mjekesore për Maternitetin e Beratit	NR REF-85003-01-27-2021
2	Loti 2- F.V paisje Hotelerie per Maternitetin e Beratit	NR REF-85005-01-27-2021

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje	Qira	Leasing	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër.

--

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: __
(Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .	
------------	--	--

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: Spitali Rajonal Berat

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

2. Fondi limit total: 59 464 949
(pesedhjeteeentemilioneqaterqindegjashtedhjeteeekatermijeenteqindedyzeteenente) leke pa TVSH.
3. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, _____.
3. Burimi i Financimit: **BUXHETI I SHTETIT**
4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër : **“F.V pajisje hotelerie dhe mjekesore per maternitetin e Beratit”.**

Loti 1: “F.V pajisje mjekesore per Maternitetin e Beratit”, me fond limit: 50 212 610
(pesedhjetemilionedyqindedybedhjetemijeegjashteqindedhjetete) leke pa TVSH.

Loti 2: “F.V pajisje hotelerie për Maternitetin e Beratit ”, me fond limit: : 9 252 339
(nentemilionedyqindepesedhjeteedymijeetreqindeetridhjeteeenente) leke pa TVSH.

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë **45** ditë nga data e lidhjes se kontrates

ose

duke filluar nga // me përfundim në /

2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: ose **ditë:** (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër(jo më shumë se (4) vjet)
Ose duke filluar nga (dd/mm/vvvv)
Përfunduar më (dd/mm/vvvv)

2.10 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër: Spitali Rajonal Lezhe

2.11 Ndarja në LOTE:

Po X Jo

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i LOTEVE)

Loti 1: “F.V paisje mjekesore per Maternitetin e Beratit”, me fond limit: 50 212 610 (pesedhjetemilionesdyqindedybedhjetemijeegjashteqindendhete) leke pa TVSH.

Loti 2: “F.V pajisje hotelerie për Maternitetin e Beratit ”, me fond limit: : 9 252 339 (nentemilionesdyqindepesedhjeteedymijeetreqindeetridhjeteeente) leke pa TVSH.

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga në

2.14 Do të pranohen variantet:

Po Jo

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po Jo

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: _____

Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po Jo

Shenime te tjera:

Ne mbeshtetje te Njoftimit te Perbashket Nr.25366 Prot te DPT dhe Nr.8480 Prot. Te APP-se date 30.12.2020 informojme te gjitha Operatoret Ekonomike se per nenshkrimin e nje kontrate publike ne perfundim te procedures duhet te kete:

-kopje te Certifikates elektronike per Fiskalizimin, tatimpaguesit qe perdorin Platformen Qendrore te Faturave.

-Kopje te Certifikates elektronike per Fiskalizimin dhe Kopje te vlefshme te Kontrates se lidhur me Shoqerine e Certifikuar per zgjidhjen softeware-ike ne perdorim, per tatimpaguesit qe leshojne faturat nepermjet zgjidhjes software-ike.

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit:

Po Jo

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standardet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 9.

3.2 Sigurimi i Ofertës²: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 4. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E Hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po Jo

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar _____

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar _____

² Sigurimi i ofertes nuk kërkohet në procedurat e prokurimit me vlerë më të ulët se kufiri i lartë monetar

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

Ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë

etj. pikë

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **01/03/2021** (dd/mm/vvvv) Ora: **12:00**

Vendi: **SPITALI RAJONAL BERAT**

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **01/03/2021** (dd/mm/vvvv) Ora: **12:00**

Vendi: **SPITALI RAJONAL BERAT**

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: **180** (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip Anglisht
Tjetër _____

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po Jo

Nëse Po

Monedha _____ Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **28/01/2021**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Rajonal Berat/Armelin Çili
Adresa Lagjia Kushtrim Berat
Tele/fax 0035/32-34 237/0694598444
E-mail spitaliberat@shendetesia.gov.al/armelin73@gmail.com
Faqja e Internetit _____

2. Lloji i procedurës së prokurimit: E HAPUR

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: NR REF-84998-01-27-2021

1	Loti 1-F.V paisje Mjekesore për Maternitetin e Beratit	NR REF-85003-01-27-2021
2	Loti 2- F.V paisje Hotelerie per Maternitetin e Beratit	NR REF-85005-01-27-2021

5. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “F.V pajisje hotelerie dhe mjekesore per maternitetin e Beratit”.

Loti 1: “F.V paisje mjekesore per Maternitetin e Beratit”

Loti 2: “F.V pajisje hotelerie për Maternitetin e Beratit

5. Fondi limit : Fondi limit total: 59 464 949

(pesedhjeteeentemilioneaterqindegjashtedhjeteeatermijeenteqindedyzeteenente) leke pa TVSH.

Loti 1: “F.V paisje mjekesore per Maternitetin e Beratit”, me fond limit: 50 212 610

(pesedhjetemilioneedyqindedybedhjetemijeegjashteqindedhjetete) leke pa TVSH.

Loti 2: “F.V pajisje hotelerie për Maternitetin e Beratit ”, me fond limit: : 9 252 339

(nenteemilioneedyqindepesedhjeteedymijeetreqindeetridhjeteeente) leke pa TVSH.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Brenda 45 (dyzeteepese) diteve nga data e lidhjes së kontrates.

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 01/03/2021 Ora: 12:00.

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 01/03/2021 Ora: 12:00.

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit
- 1.5 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e vërtetë, operatori ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 13, pika 3, gërma (a) të LPP-së.
- 1.6 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
- a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).
- b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)
_____,
_____,
_____.
- c) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas shtojcës 2/1.
- ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 8.
- d) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)
- Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në Marrëdhëniet e Punës“, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës (ku përfshihen edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me fëmijë në gji, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjislacionin të punës në tërësi.

- 1.7 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit _
**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv
_____ orës _____”**

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

- 1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: “**MODIFIKIM OFERTE**” ose “**TËRHEQJE OFERTE**”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasinë dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4. Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkursi midis operatorëve ekonomikë, palë në marreveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
 - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëminë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

Ku:

P_o - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$ - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{min k1} \times P_{max k1} / O_{k1}$$

P_{k1} _____	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{min k1}$	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
$P_{max k1}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O_{k1}	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më mëposhtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta
M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme
n – Numri i Ofertave të vlefshme
Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet <Z_M..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.4. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
i. garanci bankare

- ii. garanci sigurimi

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje

Shtojca 2/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur

Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit

Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme

Shtojca 8/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave Ligjore në marrëdhëniet e punës

Shtojca 9: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes

Shtojca 10: Specifikimet teknike

Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar

Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anulimit

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
Çmimi Neto)					
TVSH (%)					
Çmimi Total					

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehur në përqindje	Afati i levrimit

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 2/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË

Për paraqitje Oferte të Pavarur

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: _____; nga Autoriteti Kontraktor: _____; me objekt: _____; me fond limit: _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik _____, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: _____ që:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
 - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
 - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):

- a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
- b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).
7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
- a) çmimet ;
- b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
- c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
- d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

Shtojca 3

[Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës _____

Oferta duhet të paraqitet

.....

[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

Shtojca 4.

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE REALIZIMIN E OBJEKTIT SIPAS GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë si dhe marrim përsipër realizimin e objektit sipas grafikut të lëvrimit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejta ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësi të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohe në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 8

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilësinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
- Personi/at në cilësinë e *anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik*, si më poshtë:

_____ etj.

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP³.

- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).
- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatorit ekonomik si më sipër.

³ Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar në këtë Deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 8/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE LIGJORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____, **deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:**

- Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT (për lotin 1)

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT(për lotin 1)

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1*

b. *Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;*

c. *Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;Jo*

ç. *Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;*

d. *Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;*

dh. *Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 8/1;*

e. *Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.*

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

- sipas Kriteve të Përgjithshme të kualifikimit

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. *Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2017-2018-2019). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë jo më e vogël se 40% e fondit limit të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron.*

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

1. Furnizime të mëparshme të ngjashme Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së fondit limit të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të kësaj procedure prokurimi.

Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasinë e mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasinë e mallrave të furnizuara.

2. *Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST).*

3. *Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001:2015 /ose/ ekuivalent, ose ISO 13485 "Per Sistemin e menaxhimit të cilësive për pajisjet mjeksore", /ose ekuivalent/, të vlefshme, për prodhuesin/t e artikujve të ofruar ose ofertuesi të paraqes një vetëdeklarim që furnizuesi është konform standardeve të cilësisë, dhe AK të rezervojë të drejtën për verifikimin e vetëdeklarimit në procesin e vlerësimit të dokumentacionit si dhe në rastin kur OE shpallet fitues, AK të kërkojë paraqitjen e certifikatës në fjalë.*

Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Certifikata të jetë brenda afatit të vlefshmerisë, në gjuhën shqipe ose të përkthyer dhe të noterizuara.

4. Ofertuesi duhet të jetë i certifikuar ISO 9001:2015 për tregëtim të pajisjeve mjekësore /ose/ ekuivalent . Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatat përkatëse, të vlefshme. Certifikata te jete leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

5. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikata konformiteti CE ose FDA sipas direktivës (MDD ose MDR) 93/42 EEC, të vlefshme, ose ekuivalent, për artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre.

6. Operatori ekonomik duhet të paraqese autorizim nga kompania prodhuese për tregëtimin e artikujve të ofruar apo nga distributori i autorizuar nga prodhuesi ose nga distributori i autorizuar.

7. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim për tregëtim të pajisjeve mjekësore, të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, sipas ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

8. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe në pjeset që kanë lidhje me specifikimet teknike të kërkuara në DST)

9. Deklarate për përmbushjen e afatit të garancisë (1(nje) vit garanci, përfshirë blerjen dhe zëvendësimin e pjesëve të defektuara me pjesë këmimi të reja dhe origjinale).

10. Duhet të paraqitet vetëdeklarata:

- Që merr përsipër trajnimin e X personave (mjekë dhe teknikë) për çdo pajisje.*
- Për furnizimin sipas kërkesës së AK, me pajisje të reja, sipas prodhuesit të deklaruar në oferte.*
- Për përmbushjen e afatit të garancisë sipas përcaktimeve në specifikimet teknike të DST.*
- që merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit, montimit si dhe vendosjen nëpër vende të të gjithë artikujve në vendin e dorëzimit.*

11. Ofertuesi duhet të ketë në stafin e tij jo më pak se 2 (dy) inxhinierë biomedikale ose elektronik ose informatik ose elektrike ose megatronike të trajnuar për servis pajisjesh mjekësore.

Per kete duhet të paraqese:

- Diplomat përkatëse*

- Listëpagesat e miratuara sipas formatit standart në organet tatimore për periudhën Tetor 2020 - Dhjetor 2020 ku të figurojnë emrat e tyre ose te kete kontrata bashkepunimi me inxhinieret e sipercituar per mbulimin e periudhes se garancise.

- Certifikata/ose deshmi trajnimi te tyre per pajisjet me poshte:

Monitore pacienti
Makina anestezie
Pajisje ventilimi/respirimi
Pajisje ekografie
Pajisje Mobilimi Spitalor

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të deklaruar

○ **CERTIFIKATAT E CILËSISË**

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat e kërkuara të cilësisë sipas zërave të që merr përsipër të realizojë në akt marrëveshje.

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT (për lotin 2)

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT (për lotin 2)

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1*

b. *Deklaratë për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;*

ç. *Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;*

d. *Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;*

dh. *Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 8/1;*

e. *Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.*

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

- *sipas Kritereve të Përgjithshme të kualifikimit*

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. *Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2017-2018-2019). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë jo më e vogël se 40% e fondit limit të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron.*

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

1. *Furnizime të mëparshme të ngjashme Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së fondit limit të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të kësaj procedure prokurimi.*

Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

2. *Ofertuesi duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001:2015 ose ekuivalente, "Per Sistemin e menaxhimit të cilësive", të leshuar nga organizmat e vleresimit të konformitetit të cilat janë të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombetare akreditues të njohur nga Republika*

e Shqiperise, t'i përkasë fushës së aktivitetit të ofertuesit , që përkon/përfshin objektin e kontratës që prokurohet

Ne rastin kur ofertuesi nuk është prodhues, te paraqese edhe Certifikatë ISO 9001:2015 ose ekuivalente, për prodhuesin e deklaruar te pajisjeve të mobilimit të ofertuara, te leshuar nga organizmat e vleresimit te konformitetit te cilat jane te akredituara nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise ose ofertuesi te paraqes nje vetëdeklarim qe prodhuesi është konform sistemeve të menaxhimit të cilësisë, dhe AK të rezervojë të drejtën për verifikimin e vetëdeklarimit në procesin e vlerësimit të dokumentacionit si dhe në rastin kur OE shpallet fitues. AK të kërkojë paraqitjen e certifikatave në fjalë.

Çertifikata të jetë brenda afatit të vlefshmerisë, në gjuhën shqipe ose të përkthyer dhe të noterizuara.

3- Operatori ekonomik duhet të paraqesë një certifikatë qe verteton cilesine e menaxhimit te shendetit dhe sigurise ne pune sipas standartit nderkombetar OHSAS18001:2007 ose ekuivalent. Çertifikata duhet të jetë në fuqi, e vlefshme në ditën e hapjes së procedurës dhe të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues të njohura nga Republika e Shqipërisë.

4- Ne rastin kur ofertuesi është prodhues duhet të paraqesë një certifikatë qe verteton menaxhimin e cilesise ne saldim ISO3834-2:2006 ose ekuivalent. Çertifikata duhet të jetë në fuqi, e vlefshme në ditën e hapjes së procedurës dhe të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues të njohura nga Republika e Shqipërisë.

5.Operatori ekonomik duhet të paraqesë një certifikatë qe verteton sistemin e menaxhimit te mjedisit ISO14001:2015 ose ekuivalent. Çertifikata duhet të jetë në fuqi, e vlefshme në ditën e hapjes së procedurës dhe të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues të njohura nga Republika e Shqipërisë.

6.Ne rastin kur nuk është prodhues, ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, ku në çdo rast të dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, të perkthyer dhe te noterizuar.

7. Operatori ekonomik pjesemarres, në rast se është prodhues i mobiljeve te drurit duhet te kete të punësuar per periudhen Tetor-Dhjetor 2020, nje staf punonjesh minimalisht 10 persona nga të cilët te pakten 1 (nje) punonjes duhet të jete i punësuar si Inxhinier druri, per te cilin te permbushen kerkesat si me poshte:

- Diplome

- I perfshire ne listepagesat e miratuara sipas formatit standart ose kontratë pune te vlefshme ne daten e hapjes se ofertave deri ne afatin e fundit te garancise.

Për stafin e punonjësve ofertuesi duhet të paraqesë:

a-Vërtetim për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësor e leshuar nga administrata tatimore.

b-Liste pagesat e miratuara sipas formatit standart per periudhen Tetor-Dhjetor 2020.

8.Operatori ekonomik duhet të disponojë minimumi 1 (një) mjet transporti mallrash, me

kapacitet transportues të paktën 1 (një) ton me qëllim transportin e mallit, të cilin duhet ta ketë në pronësi, huapërdorje ose me qira, dhe për të cilin duhet të paraqesë dokumentacionin përkatës, si më poshtë:

Per mjetet në pronësi të paraqiten:

➤ *Dokumentacioni që vërteton pronësinë:*

- *Çertifikata e pronësisë e lëshuar nga institucioni i autorizuar me ligj ose kontrata e shitblerjes ose kontrata e dhurimit ose çdo dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë.*
- *lejet e qarkullimit,*
- *kontrollit teknik,*
- *taksat e paguara,*
- *siguracioni.*

➤ *Dokumentacioni që vërteton marrjen me qira:*

- *Kontrate qiraje e lidhur përpara Noterit,*
- *Certifikatat e pronësisë së qiradhënësit,*
- *lejet e qarkullimit,*
- *kontrolli teknik,*
- *taksat e paguara,*
- *siguracioni*

9. Duhet te paraqitet vetëdeklarata:

- *Per furnizimin sipas kërkeses se AK, me pajisje te reja, sipas prodhuesit te deklaruar ne oferte.*

- *Për përmbushjen e afatit të garancisë (1(nje) vit garanci, përfshirë blerjen dhe zëvendesimin e pjeseve te difektuara me pjese kembimi te reja dhe origjinale).*

- *Që merr persiper të kryejë shërbimin e transportit, montimit, vendosjen nëpër vende të të gjithë artikujve në vendin e dorëzimit.*

-*Operatori ekonomik prodhues duhet te disponoje ambjente prodhimi ose magazinimi, Per kete operatori duhet te paraqese certifikate pronësie ose kontrate qeraje noteriale te ambientit e vlefshme.*

10. Operatori ekonomik prodhues duhet te disponoj makineri (punsonatrice, pjegatrice) ne ambientet e tij te cilat sherbejne per prodhimin e dollapeve, rafteve metalik.

Per te vertetuar kete te paraqese: fature blerje ose dokument zhdoganimi ose kontrate qeraje.

11. Operatoret Ekonomik duhet të paraqesin mostra per disa artikuj të cilat duhet të dorëzohen 2 (dy) ore

perpara hapjes se ofertave prane Autoritetit Kontraktor.

Lista e artikujve per te cilet do te paraqiten mostrat sipas specifikimeve teknike te dhena ne DST:

- <i>Dollap metalik me dyer</i>	<i>1</i>
- <i>Dollap rrobash per zyra (nje kanat)</i>	<i>1</i>
- <i>Karrige per salle konferencash</i>	<i>1</i>
- <i>Komodina dyshe (ushtari)</i>	<i>1</i>
- <i>Tavoline mence</i>	<i>1</i>
- <i>Tavoline pune e thjeshte</i>	<i>1</i>
- <i>Karrige statike pa krahe</i>	<i>1</i>
- <i>Raft Metalik per dosje(arshive)</i>	<i>1</i>

Mosparaqitja e mostrave perben kusht per skualifikimin e operatoreve ekonomik.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Lot 1 - F.V paisje mjekesore për Maternitetin eBeratit ”,

1-Tavoline Operatore-Obsertikale dhe gjinekologjike

- Tavoline operatore me te pakten 5 ndarje per nderhyrje te pergjithshme dhe Obstetrike.
- Tavolina te jete e pershtatshme per obstetrik-gjinekologji.
- Pajisja te jete e mbeshtetur ne 4 rrota dhe me mbeshtetje statike gjate nderhyrjeve.
- Me material special per radiolucet x-ray
- Tavolina duhet te kete pozicion fiks per ekzaminimet me pajisjen C-arm.
- Trashesia e dyshekut 80mm
- Materili i konstruktit te jete inoks dhe aliazh alumini.
- Nderrimi i aksesoreve te jete me kapse dhe jo me vida, per nje perdorim te thjeshte nga stafi mjeksor.
- Telekomanda te komunikojte me infra red dhe te kete me butona me ndricim.
- Krevati te mbaje peshe te pakten 300 kg
- Gjatesia e tavolines jo me e vogel se 2100 mm.
- Gjeresia e tavolines jo me e vogel se 500 mm.
- Zgjatje horizontale longitutinale e tavolines per skanime x-ray te pakten 400 mm
- Lartesia e tavolines te pakten 720 - 1100 mm me levizje elektronike.
- Levizjet tredelenburg te pakten 40 grad
- Levizjet ansore majtas-djathtas te pakten 35 grad
- Levizja e pjeses se shpines te pakten -40 grad deri ne te pakten +78grad
- Levizja e pjeses se kembeve te pakten 0 – 90 grad dhe e zmontueshme kur nevojitet

- Pllaken e zgjatjes, mbeshetesen e kokës, çift për kembet, mbeshetesen për krahun, mbeshetesen laterale, lidhjet për trupin, ekrani për anestezinë. Telekomanden e komandimit për levizjet e krevatit.

2-Makine Anestezie (Set)

- Makine anestezie e pershtatshme për ventilim Neonatal/Pediatrik dhe Adult.
- Sistem me 3 gaze mjekësore: O₂, N₂O dhe Ajer me auto kalibrim.
- Aparati duhet të suportoje hyrjet Ajer/O₂ dhe N₂O 250–650 kPa dhe të suportoje standartet AGA DISS NIST, etj.
- Pajisja duhet të jetë me sistem të integruar dhe me indikator në kohë reale për pastimin e gazrave.
- Sistemi i pastrimit duhet të ketë një fuqi pastruese minimum 25 l/min.
- Ekran me prekje LED dhe me knob.
- Dimensioni minimal: 15", me ngjyra.
- Shfaqje në kohë reale të grafike në ekran dhe të formave të vales mbi 6 forma valesh dhe mundësi konfigurimi nga përdoruesi.
- Trendet: të dhëna grafike, 1 deri 24 ore/ndarje
- Të dhëna numerike, 1 deri 60 minuta/ndarje
- E pajisur me një tavolinë pune me sipërfaqe afërsisht 380 mm x 240 mm
- Me llampe të integruar LED në krahun e ekranit
- Të jenë të montuar të pakten 2 sirtare
- Të ketë sistem kontrolli për të parandaluar Hipoksine duke treguar nivelin e O₂ për të ndreprere procesin.
- Ventilim: Manual/Bag, AFGO, VC, PC, PS, PRVC, SIMV
- Karakteristikat e Ventilimit:
- Fluksi i gazit: 1-120 Litra/min
- Volumi Tidal: 20 – 2000 ml, me hap nga 1 deri 10 ml
- Volumi në minute për të rritur: 0.5–60 l/min
- Frekuenca e Respirimit: 4–100 ±1 frymemarrje/minute
- Raporti I:E (VC, PC): 1:10 – 4:1
- PEEP: 0–50 cmH₂O
- Presioni i Inspirimit: 0–120 cmH₂O
- Fuqia Inspirimit: 200 l/min afërsisht
- Karakteristikat e sistemit të frymarrjes:
- Aparati duhet të përdorë sistem qarkullimi me reflektor volumi
- Sistemi duhet të sigurojë një volum maksimal jo më pak se 3000ml
- Sistemi duhet të sigurojë një maksimum humbje në metoden manuale jo më shumë se 3.5 ml/cmH₂O
- Valvola të emergjencës APL frymemarrje e rastesishme deri në 80 cmH₂O dhe për oksigjenin O₂ të pakten 0–10 l/min
- Alarmi për presionin e lartë: 10–120 cmH₂O
- Volumi i respirimit për minute: i larti 0.5–60 l/min dhe i ulet 0.01–40 l/min afërsisht
- Alarm APNEA: 5 – 45s dhe kur është i fikur. Alarmi për APNEA kur nuk ka frymemarrje për 120s

- Koncentrimin e inspirimit dhe të espirimit të Oksigjenit, CO₂ dhe agjentit anesteziq
- Kontroll në kohe reale i qarkut të frymarrjes, prani të ventilatorit alternativ me reflektor volumi
- Detektim dhe Alarm për humbje të gazit në qarkun e pacientit.
- Rimbushja e agjenteve anesteziq të kryhet në kohe reale kur pacienti është i lidhur me pajisjen.
- Alarme për detektimin e bllokimeve në lidhjen e miksimin të gazrave
- Mundësi gjurmimi të përdorimit të agjentit anesteziq për të pakten 20 pacientet e fundit.
- Koha e mbushjes së vaporizatorit afërsisht 4 ml/s
- Furnizimi me energji: Rrjeti 100–120V, 220–240V, AC 50–60Hz
- Bateria e rikarikueshme për kohën e operimit pa rryme elektrike të pakten 90 minuta

3-Llampe Operatore

- Llambë për nderhyrjet kirurgjikale
- Llamba të jeta e tipit pa hije dhe të ketë kontroll dixhital për nxehësinë.
- Llamba të jete për fiksime në tavan dhe dy krahe të rrotullueshëm
- E pajisur me dy koka (qendrore dhe satelit) me Llamba LED me kontroll automatik të ndicimit sipas thellesisë,
- Ndricimi për secilën kokë: të pakten 130,000 lux dhe të arrij të pakten 160,000 lux
- Diametri maksimal i fushës jo më pak se 30 cm
- Thellesia e volumit të dritës të pakten 70 cm
- Të jete e pajisur me sensor proksimal për kontrollin automatik të dritës në ndryshim të thellesisë
- Ngjyra të temperaturës të pakten 3600 - 4800 K e rregullueshme me hapa
- Indeksi i ngjyrave të pakten 95
- Energjia rrezes jo më pak se: 3,5 mW/m².lux
- Jetëgjatësia e LED të pakten 55,000 ore pune
- Me dorëzë të sterilizueshme për rrotullimin, ndryshimin e lartësisë dhe kendit të llampes
- Rrotullim horizontal 360 grad
- Artikulacion (nyje,lidhje) vertikale me rrotullim horizontal të pakten 350 grad
- Rrotullim vertikal mbi 300 grad
- Fiksuesi i llampes në tavan dhe mbulesa të jete të përfshira në çmimin e ofertës
- Të punoje me 220 V, 50Hz

4-Llampe Mobile

- Llampe për procedurë ekzaminimi mjekësor dhe kirurgji minore.
- Llampe ekzaminimi LED .
- Me fokus elektronik
- Tub i levizshëm mbi baze të levizshme me rrota
- Lartësi e rregullueshme afërsisht 70 - 160cm
- Llampe me hijezim të reduktuar dhe ndricim eksponencial
- Diametri i fushës së dritës së përqendruar të pakten 30 cm
- Temperatura e ngjyrës të kontrolluara elektronikisht të pakten nga 3700K deri 4700K
- Intensiteti të pakten 100,000 lux

- Jetegjatesia e LED-it jo me pak se 55,000 ore
- Diametri I satelitit jo me pak se 35 cm
- Me rregullator Intesiteti me buton
- Me rregullator te temperatures se ngjyrave me buton
- Me doreze te sterilizueshme

5-Llampe Ekzaminimi

- Llampe ekzaminimi LED
- Me fokus elektronik
- Tub fleksibel mbi baze te levizshme me rrota
- Lartesi e rregullueshme afersisht 70-160cm
- Diametri i fushes se drites te pakten 20 cm
- Temperatura e ngjyres te kontrolluara elektronikisht te pakten nga 3700K deri 4700K
- Intensiteti te pakten 50,000 lux
- Jetegjatesia e LED-it jo me pak se 55,000 ore

6-Llampe Baktericidi

- Pajisje baktericide me llampa ultraviolet dhe ventilator per purifikim-sterilizim ajri nga bakteriet dhe sporet ne ambiente spitalore
- E destinuar per instalim mural.
- Llampa UV me gjatesi vale afersisht 253 nm te vendosura ne dhome rrezatimi te mbyllur per mbrojtjen e personelit/pacienteve nga rrezatimi UV.
- Dhoma e sterilizimit UV me siperfaqe reflektuese per mosekspozimin e jashtem te rrezatimit UV.
- Energjia e rrezatimit UV mbi 65 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- Efektiviteti i sterilizimit jo me pak se 90% per bakteriet.
- Kapaciteti sterilizues i ajrit mbi 100 m³/ore
- Niveli i zhurmes se pajisjes afersisht 35 dB
- Ushqimi 220V / 50Hz

7-Elektrobisturi

- Elektrobisturi me dy dalje monopolare dhe nje dalje bipolar.
- Diapazoni i fuqise: te pakten 300W
- Te kryeje procedura te endoskopise bipolar ne solucion saline.
- Mundesi memorizimi te pakten 9 programe
- Mundesi kontrolli me celes kembe dhe me elektroda dore.
- LED-bar per kontroll vizual te cilesise te kontaktit.
- Alarme vizive te ndara me ngjyra dhe akustik
- Te kete mundesi per te funksionuar edhe me gaz Argoni dhe me aspirator tymi
- Ne perputhje me standartet IEC 60601-1 , EN 60601-1 dhe IEC 60601-2-2
- Mrojtje e Klasit te pare te shkalles CF
- Aksesoret: 1x celes pedal-kembe, 1x Pllake tokzimi neutrale gome,shumepedorimshe. 1x Elektrode thike monopolare, 1x elektrode lancet e drejte (Needle Shaft electrode). 1x Pince diatermie. 1x Elektrode me tel te harkuar (Loop electrode).

8-Karrel Instrumentash

- Karrel Instrumentash kirurgjikale
- Manovrueshmeri e madhe: 4 rrota me frena dhe qe nuk krijojne zhurme
- Rezistence e larte
- Celik Inoksidabel (qoshe të rrumbullakosura) ose tabaka të sheshtë të izoluar me tuba inoksi
- Celik te pa oksidueshem

9- Njesi aspirimi per gjinekologji

- Aspirator per adulte dhe pediatrike
- Per aspirim nazal,oral,trakeal dhe lengjev trupore (mukus, catarrh ose gjak)
- Me valvul sigurie kontrolli per te parandaluar rrjedhjen
- Kapaciteti i shishes : min 1,000 ml te autoklavueshme ne 121°C
- Rrjedha (litra ajer /min): min 25 l/ min - min 40 l/min
- Thithja maksimale : 0.80 bar (600mm/Hg)
- Ushqimi : 220-230 V - 50/60 Hz
- Konsumi : 106 W Pesha: min 3.6 kg

10-AED external me monitor

- Defibrilator Bi-Fazik me Pacer per arrestet kardiake akute dhe kronike
- Menyrat e punes: Manuale, Pacer, AED dhe Monitorim.
- Mundesi Monitorim te formave valore: ECG 3/5 lead, SpO2, NIBP, IBP, etj.
- Te kete te instaluara funksionet per SpO2, NiBP, Temperature, CO2 dhe IBP.
- Me karikues dhe bateri dhe tregues digjital ne ekran te gjendjes te baterise.
- Pajisja me madhesi ekrani jo me te vogel se 8.2 inch
- Tipi i ekranit ST-NLT ngjyrim TFT
- Nr. i gjurmimit 6 forme valesh
- Diapazoni i energjise: min 2- 270 J
- ECG Lidhje Kabell me 3, 6 dhe 10 elektroda
- Numri I kanaleve te EKG: 2 (maksimum, me 6 ose 10 elektroda te shfaqura ne ekran), 12 (maksimum, me 10 elektroda ose dritare me 12 drejtime)
- Shkalla e numërimit të rrahjeve te zemrës Defribilim ose modeli i monitorimit: 15 deri ne 300 bpm
- Shkalla e paraqitjes se ritmit te zemres: 15 ne 220 bpm
- Diapazon i paraqitjes 0 deri ne 100%SpO2
- Saktesia e Matjeve $80\%SpO2 \leq \%SpO2 \leq 100\%SpO2$; $\pm 2\%SpO2$; $70\%SpO2 \leq \%SpO2 < 80\%SpO2$; $\pm 3\%SpO2$
- Diapazon i llogaritjes se shkalles se frymemarrjes: 3 deri ne 150 llogaritje/min $\pm 10\%$ dhe koha e përgjigjes brenda 3 s.
- Termat e shfaqur Sistolike (SYS), diastolike (DIA), mesatarja (MAP)
- Invasive blood pressure (IBP) Diapazon i matjeve -50 deri ne +300 mmHg
- Diapazon i matjes se temperatures: 0 deri ne 45°C
- Saktesia e matjes se temperatures se pacientit $\pm 0.1^\circ C$
- Forma e vales ne dalje Bifazike, me shperndarje eksponenciale konstante te copezuar

- Koha e ngarkimit ne metoden mauale ne kapacitet 270 J, jo me shume se 5 s
- Koha e ngarkimit ne metoden AED ne kapacitet 270 J, jo me shume se 15 s
- Shkarkimi i sinkronizuar i perfshire.
- Ritmet e shmangies në sistemin elektrik të përçimit të zemrës. VT $\geq 75\%$
- Pajisur me printer termal
- Me karte memorie per mundesi rregjistrimi.
- Doreze te inkorporuar
- Duhet te kete alarme si dhe sinjale vizuale: Gjendje kritike me sinjal te kuq, gjendje qe duhet pasur kujdes me sinjalizim te verdha, nevoje konsultimi me ngjyre te kalter.
- Aksesoret: 1x kabell ECG me 3 lead, 1x Set pllakash te riperdorshme adulte dhe pediatrike, 5 x Sete pllakash nje-perdorimeshe adulte dhe 5 sete pediatrike, 100 x Elektroda ECG njeperdorimshe, 1x kabell dhe Sensor SpO2 Adult, 1x Konektor dhe manshete NIBP Adult dhe pediatrik, 1x Sensor temperature Adult, 20 x rulona leter termike per printer, 1 x shishe xhel.

11-Ambu adult

- Aparat (Reanimacioni) Ambu per te rritur
- Masa e maskes per Adult Nr. 4 dhe Nr. 5 te perfshira
- Me valvul pacienti me presion jo me pak se 6.0 kPa dhe me rezervuar te pakten 1600 ml, PVC
- Maske silikoni Te autoklavueshme deri ne 134 °
- Tub oksigjeni 2 m
- Garancia 1 vit

12- Ambu neonati dhe premature

- Aparat (Reanimacioni) Ambu
- Masa per peidatrik dhe neonate Nr. 1 dhe Nr. 3 te perfshira
- Volumi I qese se pare 280ml dhe I te dytes 500ml , qese PVC
- maske silikoni Te autoklavueshme deri ne 134 °
- Tub oksigjeni 2 m
- Garancia 1 vit

13-Kompet instrumentash obsetrikal

- Foerster forceps - 25 cm
- Sims histerometer - 33 cm - silver
- Bosch/Sims scissors - 23 cm
- Schroeder forceps - 25 cm (Pozzi - Palmer)

Te kete te perfshire edhe setin e suturimit me artikujt si meposhte:

- Cistine te mesme
- Galipot 150 ml - 6 oz – e mesme
- Mayo Hegar mbajttese e ages - 18 cm
- Kocher artery forceps – e drejte - 16 cm
- Kocher artery forceps – e harkuar - 16 cm
- Pince shperndarese me dhembeza 1x2 - 14 cm

- Gershere suturimi - Heaths Ligature - 15 cm
- Gershere Mayo - e drejte - 15 cm
- Mbajtese e instrumentave 30 x 20 x 5 cm

14-Set Abrazio

- Set Spekulum Vaginal
- Set Dilatator Uterine Hegar Cervical Masa 3 – 15mm me gjysma
- Sonde Uterine afersisht 28cm e drejte $\phi 3$
- Forceps tamponimi 25 cm me gjeresi afersisht 8 e drejte dhe e harkuar dhe 12 e drejte dhe e harkuar
- Forcepr POZZI 25 cm me 1x2hook
- Forceps cervical 25cm e drejte me 2x3 dhembe
- Kanjula aspirimi me 4 dimensione te ndryshme
- Set dilatator dhe kyretazhi me te pakten 6 permasa te ndryshme

15- Cardiotohograf i zakonshem me opsion printimi

- Kardiototograf per binjake
- Per perdorim te pergjithshem per rrahjet e zemres se fetusit, levizjet e fetusit ne menure automatike dhe kontraksionet e paralindjes.
- I pajisur me afishues te HR dhe printer termal.
- Me frekuence pune 1.0 Mhz.
- Me bateri per te pakten 3 ore pune me pavararsi nga rrjeti
- Te kete mundesi lidhjeje me sistem qendror monitorimi.
- Aksesoret: Sonda ultrasonike - 2 cope, Sonde Toko - 1 cope, Shenues ngjarjesh - 1 cope, Xhel - 1 cope, Rripi fiksues - 1 cope, Leter Printeri - 1 cope

16- Shiringe Infuzioni elektrike

- Volumi i infuzionit te pakten nga: 0.1 ne 1200 ml/h me hap 0.1mL/H
- Kapaciteti i shiringes: minimum 10, 20, 30/35, 50/60 cc.
- Administrimi i bolus manualisht ne intervalin 50 ne 1200 ml/h dhe hap 50ml/h
- Saktesia $\pm 1\%$ me nje minimum shiringash 100.
- Numri eventeve me shume se 1000.
- Te operoje ne presion 250-900 mmHg ne hapa 50 mm Hg ose ne hapa 25 mmHg per presion 50-250 mmHg.
- Shkalla e KVO: e mbyllur ose 0.1-5.0ml/h
- Njesite e dozimit g, mg, μ g, ng, U, mmol, etj.
- Te kete te pakten 50 lloje ilacesh te programuar.
- Kapaciteti i shiringave: 5-50/60 ml
- Tipi i Ekranit te jete monokrom min LCD afersisht 63 mm x 28 mm
- Modaliteti I infuzionit duhet perfshije: nderhurjen standarte, kalkulimin e dozesh, TIVA, TCI
- Furnizimi me energji elektrike: 100-240v, 25 VA, 50-60 Hz.
- Klasa e mbrojtjes ndaj ujit te pakten: IP22.
- Mbrojtje nga defibrilimi Class II CF.

- Ne perputhje me standartet EN / IEC 60601-1 dhe EN / IEC 60601-2-24 / dhe ne perputhje me EEC / 93/42.
- Bateria: Li/Ion, Min. 11h ne 5mL/h dhe 6h at 5mL/h nese perdoret komunikimi wireless.
- Koha e karikimit jo me shume se 6h ne gjendje OFF.

17- Aparat ECHO Obsetrikale 2D, 3D, 4D

- Eko dopler me ngjyra per Obstetri dhe Gjinekologji
- Model i levizshem me rrota me mbeshtetje ne dysheme.
- I kontrolluar me mikroprocesor, teknologji dixhitale dhe kanale dixhitale
- Paketa llogaritjesh per testime Gjinekologjike, Obstetrike, Abdominale, Urologjike, Pjese te vogla, Vaskulare, Pediatrike
- Te mundesoje egzaminime Elastografie per qafen e mitres dhe gjirin.
- Te kete te pakten 3 porta per sonda aktive.
- Menyrat e operimit: 2D, 3D, 4D, te perfshira dhe instaluara ne aparat ne menyre permanente.
- Monitori i imazhit i sheshte (LCD/LED), me ngjyra.
- Madhesia e ekranit mbi 21", me rezolucion te larte HD.
- Paneli i kontrollit me lartesi te rregullueshme, i pajisur me ekran (LCD/LED) me prekje, per komandim/kontroll funksional dhe vizualizim imazhi ekografik ne ekran. Madhesia minimale: 13" me rezolucion te larte HD.
- Monitori i rrotullueshem, me lartesi dhe kend te ndryshueshem.
- Intervali Dinamik maksimal mbi 240 dB
- Thellesia e skanimit te pakten deri ne 40 cm
- Intervali i frekuencave te funksionimit 2.5 deri ne 16MHz
- Perfshin funksione cine me memorizim te shume cikleve.
- Shpejtesia maksimale e nderrimit te imazhit mbi 1200 frames/sec
- Perfshin Menyrat e shfaqjes se imazhit: B-Mode, M-Mode, Color M Mode, Color Doppler Mode, Power Doppler (PD), 3D, 4D, Beam Steering, Harmonic Imaging, TDI.
- Te kete mundesi per shtese te elastografise

Perfshin Sondat:

Sonde Volumetrike Endovaginale multifrekuence me bande te gjere afersisht 3 – 12.5 MHz

Fushepamja deri ne 195 grade

Numri i elementeve: minimum 191

Thellesia e skanimit 1.5 deri ne 28 cm

Sonde Lineare multifrekuence me bande te gjere afersisht 4 - 13.5 MHz.

Fushepamja deri ne 3.5 cm

Numri i elementeve: minimum 128

Thellesia e skanimit 1.5 deri ne 28 cm

- Te kete memorije te brendshme HDD jo me te vogel se 850 GB
- CD/DVD-RW te inkorporuar
- Te kete te pakten 3 porta USB 2.0.
- DICOM 3.0 me licence aktive te perhershme
- Porte network (Ethernet)

- Porte per Video Out dixhitale
- Video Printer Bardh e Zi

18-Pompe infuzioni

- Portabel. Sistem baze me mikroprocesor
- Ushqimi; AC- 220V, 50Hz dhe bateri.
- Monitor digital per tregimin e vlerave.
- Infuzion KVO (per mbajtjen hapur te venes)
- Sistemi i infuzionit: PERISTALTIK
- Presioni i infuzionit i rregullueshem
- Memorizim it e dhenave ne rast nderprerje e energjise
- Ndryshim i parametrave te infuzionit pa nderprere procedure e infuzimit
- Bateri e integruar e rikarikueshme. Karikohet automatikisht gjate punes.
- Kalim automatik ne regjim baterie ne rast nderprerje te energjise
- Kohezgjatja e baterise ne regjim pune; te pakten ne 8 ore.
- Karakteristikat
- Fluksi : 0.1-1500 ml/ore
- Vellimi i infuzuar : 0.1-9999 ml me rritje prej 0.1 ml-1ml
- Koha e infuzionit: 1 s – 165 ore e 59 minuta
- Shpejtesia e bolusit: I rregullueshen deri ne 1500 ml/ore
- Saktesia: $\pm 5\%$
- KVO e rregullueshme 1 – 20.0 ml/ore
- Pajisur me modalitet kontrolli te ndryshueshem gradual ose te paracaktuar ne 3 nivele
- Pajisur me sistem dinamik per te sinjalizuar ndryshimin e presionit
- Alarme vizive dhe akustike per raste te ndryshme: Rastet: bateri e ulet, afrimi i mbarimit te infuzionit, rritje e presionit, fund infuzioni, fluks i ulet, bllokim i linjes, keqfunksionim i brendshem, ajer ne sistem, kapak i hapur.
- Te mundesoje integrimin e librarise se ilaceve te ndryshme
- Numri eventeve te pakten 1500
- 15-Karrel Instrumentash kirurgjikale
- Manovrueshmeri e madhe: 4 rrota me frena dhe qe nuk krijojne zhurme
- Rezistence e larte
- Celik Inoksidabel (qoshe të rrumbullakosura) ose tabaka të sheshtë të izoluar me tuba inoksi
- Celik te pa oksidueshem
- 16-Shiringe Elektrike
- Volumi i infuzionit te pakten nga: 0.1 ne 1200 ml/h me hap 0.1mL/H
- Kapaciteti i shiringes: minimum 10, 20, 30/35, 50/60 cc.
- Administrimi i bolus manualisht ne intervalin 50 ne 1200 ml/h dhe hap 50ml/h
- Saktesia $\pm 1\%$ me nje minimum shiringash 100.
- Numri eventeve me shume se 1000.
- Te operoje ne presion 250-900 mmHg ne hapa 50 mm Hg ose ne hapa 25 mmHg per presion 50-250 mmHg.
- Shkalla e KVO: e mbyllur ose 0.1-5.0ml/h
- Njesite e dozimit g, mg, μg , ng, U, mmol, etj.

- Te kete te pakten 50 lloje ilacesh te programuar.
- Kapaciteti i shiringave: 5-50/60 ml
- Tipi i Ekranit te jete monokrom min LCD afersisht 63 mm x 28 mm
- Modaliteti I infuzionit duhet perfshije: nderhurjen standarte, kalkulimin e dozesh, TIVA, TCI
- Furnizimi me energji elektrike: 100-240v, 25 VA, 50-60 Hz.
- Klasa e mbrojtjes ndaj ujit te pakten: IP22.
- Mbrojtje nga defibrilimi Class II CF.
- Ne perputhje me standartet EN / IEC 60601-1 dhe EN / IEC 60601-2-24 / dhe ne perputhje me EEC / 93/42.
- Bateria: Li/Ion, Min. 11h ne 5mL/h dhe 6h at 5mL/h nese perdoret komunikimi wireless.
- Koha e karikimit jo me shume se 6h ne gjendje OFF.

19 – Pajisje per monitorimin e parametrave vital Adult

- Monitori te kete ekran TFT LCD 12.1 inch
- Te mundesoj pune te vazhdueshme per te pakten 2 ore
- Paramentrat: ECG, SPO2, NIBP, Temp, Resp., HR/PR

ECG

- 5 elektroda (R, L, F, N, C or RA, LA, LL, RL, V)
- Zgjedhshi I elektrodave: I, II, III, avR, avL, avF, V,
- Formevala : 2 ch
- Lead modeL:3 Leads (R, L, F or RA, LA, LL)
- Selektimi I elektrodave:I, II, III,
- Formevala : 1 ch
- HR dhe Alarm
- Rangu
- Adult 15 ~ 300 bpm
- Saktesia $\pm 1\%$ or ± 1 bpm,which great
- Rezolucioni 1 bpm
- Sensitiviteti > 200 (uV P-P)
- CMRR
- Monitor > 105 dB
- Operimi > 105 dB
- Diagnostika > 85 dB
- Intervali I sinjalit ECG ± 8 m V (Vp-p)
- Gjeresia e Bandes
- Nderhyrje 1 ~ 15 Hz
- Monitor 0.5 ~ 35 Hz
- Diagnostik 0.05 ~ 100 Hz
- Dedektimi ARR
- Tipi: ASYSTOLE, VFIB/VTAC, COUPLET, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ON T, VT>2, PVC, TACHY, BRADY, MISSED BEATS, PNP, PNC
- Alarm I mundur
- Rishikimi I mundur

RESPIRACIONI

- Metoda Impedenca ndermjet R-F(RA-LL)
- Rangu I matjes se impedences: 0.3~5.0Ω
- Gjeresia e bandes 0.3 ~ 2.5 Hz
- Rangu I matjes dhe alarmit
- Adult 0 ~ 120 rpm
- Rezolucioni 1 rpm
- Saktesia ±2 rpm

NIBP

- Metoda: Oksilimetrik
- Mode: Manual, Auto, STAT
- Intervali I matjes ne: AUTO, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240,480 (Min)
- Niveli I rrahjeve te zemres 40 ~ 240 bpm
- Alarm SYS, DIA, MEAN

Adult

- SYS 40 ~ 270 mmHg
- DIA 10 ~ 215 mmHg
- MEAN 20 ~ 235 mmHg

SpO2

- Intervali I Matjes 0 ~ 100 %
- Intervali I alarmit 0 ~ 100 %
- Rezolucioni 1 %
- Rezolucioni 1bpm
- Saktesia ±2bpm

TEMPERATURE

- Nr I kanaleve 2
- Matja dhe rangu u alarmit 0 ~ 50 °C
- Rezolucioni 0.1°C
- Saktesia ±0.1°C

20- – Pajisje per monitorimin e parametrave vital Adult

- Sistem Modular Monitor Pacienti per mundesine e reazimit te matjeve te parametrave vitale:
- ECG (3/6/10 lead), HR, SpO2, NIBP, IBP, Temperatures (2 kanale), Parametrat Hemodinamike, CO, CO2 ne metoden mainstream dhe sidestream, Flow/Paw, BIS, Gazrave anestezik(CO2, O2, N2O) si dhe parametrat NMT, Ventilimon, CCO dhe EEG.
- Monitori duhet te jete i pershtatshem per kategorite e perfshira: femije, neonatal:
- Ekran i sheshte TFT/LCD/LED me prekje min 12 inch me mundesi afishimi te pakten 15 te formave te vales. Te kete alarm visual me 3 nivele ngjyrash te ndryshme sipas rendesise.
- Monitori duhet te kete mundesi e bllokimit te komandimit me prekje dhe te ofroj mundesi kontrolli ndermjet butonave fizik. Regjistrim I te dhenave grafike dhe parametrave te pakten 72 ore.
- Mbrotjtje nga defribilimi dhe hyrjeve sipas standarteve IEC 60601-2-27 17.101

ECG:

- ECG (3/6/10 lidhje),
- Diapazoni min 15-300 bpm. Saktësia jo me shume se ± 2 bpm.
- Mbrojtje dhe sinkronizim me defibrilatorin.
- Zbulim te segmentit –ST. Me algoritem per aritmi dhe pacemaker.
- Alarme vizuale dhe zanore.

SPO2

- Te pershtatet me standartet ISO 9919: 2005, ISO 80601-2-61:2011
- Diapazoni 1-100%
- Diapazoni i Pluse 20-300 bpm
- Saktësia $\pm 3\%$
- Drita e sensorit minimumi 0.13mW
- Me dy forma vale min 660/940 nm

Respirimi:

- Metoda: matje e impedences elektrike
- Diapazon: 30-200 bpm (te rritur); 4-120bpm (porsalindur/femije)
- Saktësia : ± 5 rpm. Alarme per rrezet e matjes.
- Hapat e matjes: 0, 4 deri 60 hapa/min
- Saktësia e matjes: ± 1 numerim/min
- Interval I larte: 2 deri 150
- Interval ulet 0 deri 148
- Alarmi Apnea : Fikur, 5 deri 40 s ne 5 hapa

NIBP(Presioni i gjakut jo Invaziv)

- Metoda: Oshilometri Automatike
- Menyrat: Interv/automatike/vazhdueshme. Per Neonate, Pediatrik dhe Adult
- Diapazoni: min 10-280mmHg.
- Tipi i matjes: sistolik, Interval dhe mesatar: Sistolik: 40 deri 280 mmHg; Diastolik: 10 to 235 mmHg; (MAP): 10 deri 280 mmHg;
- Neonate: Sistolik: 30 deri 140 mmHg; Diastolic: 10 deri 110 mmHg; (MAP): 10 deri 140 mmHg
- Pediatrik: Systolic 40 deri 280 mmHg, Diastolic: 10 deri 235 mmHg, MAP: 10 deri 280 mmHg
- Saktësia te jete sipas standarteve ISO 81060-2 (perkatesisht $\leq \pm 5$ mmHg dhe $\leq \pm 8$ mmHg)

Temperatura:

- 2 kanale, 1 sonde per matjen e temperatures ne diapazonin: 0-45°C.
- Rezolucion: 0.1°C. Saktësia: ± 1 °C.
- Pajisur me alarm per temperaturat jashte diapazonit te matjes.
- IBP (Presioni i gjakut invaziv)
- Mundesi matje me 2- kanale
- Interval ii matjes: -40÷300 mmHg. Saktësia e matjes: $\pm 5\%$.
- Alarme: arrhythmia, apnea, HR, RR, PR, ST, APNEA, TEMP, deltaTEMP, Ppeak, SpO2, NIBP, IBP, ETCO2, CO2, CCO, O2 insp, O2 exp, Tb, MV, VPC, PEEP, N2O Agent, SEF, BIS, CCI, TP, etj.

- Alarmet e Arrhythmia: te pakten 20 aritmi te ndryshme ku te perfshihen BRADYCARDIA, PROLONGED RR, BIGEMINY, ASYSTOLE, EARLY VPC, PACER NON-CAPTURE, NO PACER PULSER, etj

Aksesorete ofruara nga prodhuesi dhe te shoqeruara me CE/DC:

- Konektor per EKG me 3/6/10-lead. Per Pediatrik dhe Neonat, nga 5 set elektrodash me nje perdorim per secilen mase.
- Manshete NIBP Pediatrik nga 5.
- Sensor SpO2 Pediatrik nga 3 secila me shume perdorime me kabell dhe konektor elektrik.
- Sonde lekure temperature Pediatrik nga 2 .
- Bateri e integruar e rikarikueshme per pune normale per tepakten 1.5 ore. Mundesi per te shtuar bateri te dyte.

21-Radiante

- Sistem Ngrohës për neonate
- I pajisur me rezistencë ngrohëse 0÷500W. Modalitet funksionimi Manual dhe Automatik (servo mode).
- Te ketë ekran të pakten 8 inch për afishimin e temperaturës dhe parametrave të tjera
- Te afishojë Apgar – timer (kronometër)
- Sistem i pajisur me një portë për sensor temperaturë me vendosje sipërfaqësore (në lekure).
- Te ketë mundësi manuale dhe automatike të kontrollit të temperaturës ose nëpërmjet sensorit të temp
- Modalitet Funksionimi Manual
- Në modalitet Manual Intensiteti i energjisë ngrohëse duhet të rregullohet manualisht nga operatori në të pakten 50 nivele energjie nga 0-100%.
- Modalitet Funksionimi Automatik
- Në modalitet Automatik (servo), të kontrollohet energjia ngrohëse në mënyrë automatike sipas temperaturës së dëshiruar për pacientin (setpoint) dhe sipas informacionit të marrë nga sensori i temperaturës (feedback).
- Intervali i rregullimit të temperaturës: 34÷38°C me rezolucion 0.1°C.
- Te jetë i pajisur me llambe ndricimi për perdoruesin
- Dimensionet e peraferta të platformës së pacientit afërsisht 450 x 650 mm
- Platforma duhet të mundësojë vendosjen e kasetave X-ray duke mos levizur pacientin.
- Platforma e pacientit duhet të mundësojë pozicionim horizontal në këndet 0° ±12°.
- Mundësi rrotullimi të kokës së rrezatimit ±90° për të mundësuar vendosjen e pajisjeve të tjera (njësi portative x-ray, njësi fototerapie, etj.)

22-Aparat fototerapie (llampe fototerapie)

- Te jetë i pajisur me sistem LED dhe intensitet të lartë.
- Te ketë të pakten 20 LED dhe fuqia jo më shumë se 20W
- Sistemi LED të ofrojë jetegjatesi të pakten 35,000 ore pune
- Te ketë sistem për mbrojtjen ndaj personelit mjekësor.
- Rrezatimi i sistemit LED të ketë gjatësi vale 450 nm [$\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$] në fushë 54 - 56cm
- Fusha e rrezatimit në 440 - 460 nm [$\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$] të mbulojë lartësinë 43 – 45 cm

23-Aparat CPAP

- Pajisja perbehet nga Njesia CPAP dhe Lageshtues
- Njesia CPAP:
- Pajisje per terapi CPAP per neonate me kontroll dhe monitorim te %O2 ne intervalin: 21-100%
- Perzjeres gazesh (Ajer dhe O2) i integruar ne pajisje.
- Fluksimeter i integruar ne pajisje per flukse nga 1-15 Litra/minute
- Te jete i pajisur me display LCD ku shfaqen parametrat e CPAP.
- Presioni i gazeve ne hyrje te pajisjes: 3.5-6 atm.
- Furnizim nga rrjeti AC 220V/50Hz dhe bateri e integruar per te garantuar funksionim per te pakten afersisht 1 ore.

Lageshtues:

- Lageshtues i pershtatshem per t'u perdorur ne kombinim me njesine CPAP te pershkruar mesiper.
- Sistem lageshtimi me dhome uji (chamber).
- Kontroll i temperatures se gazit ne qarkun e pacientit nepermjet ngrohjes ne intervalin afersisht: 30-40°C
- Monitorim i temperatures se gazit nepermjet sensoreve te vendosur ne qarkun e pacientit.
- Furnizim nga rrjeti AC 220V/50Hz.

Aksesoret: Te perfshihen sensoret e temperatures se lageshtuesit, Te perfshihet nje strukture metalike e levizshme me rrota ku do te montohen njesia CPAP dhe Lageshtuesi. Te perfshihen 5 qarqe pacienti njeperdorimesh neonatal me rezistenca te integruara te pershtatshem per t'u perdorur sebashku me njesine CPAP dhe lageshtuesin e mesiper.

24-Peshore femijesh dixhitale

- Peshim per femije deri ne 20 Kg
- Ekran LCD per leximin e te dhenave
- Njesia ne Kg ose ne Lb
- Operim i thjeshte me nje buton
- Pjata e vendosjes se femijes me mundesi shkeputjeje
- Funksion auto-off per kursim energjie
- Funksion me bateri
- Shkalle matese gjatesie modulare (vendoset dhe hiqet sipas nevojave)

25-Peshore adulte

- Ekran elektronik
- Duhet te jete ne konformitet me normat: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, 2011/65/EU, 1999/5/EC, 93/42/EEC
- E lehte per transport
- Kapaciteti maksimal 200 kg/450 Ibs dhe hap 100 g/ 0.2 lbs
- Dimensionet e peraferta : 294 x 831 x 417 mm / 11.6 x 32.7 x 16.4"
- Dimensionet e platformes: 272 x 75 x 280 mm / 10.7 x 3 x 11"
- Ushqimi Bateri/Adaptor AC/DC
- Funksione: TARE, mbajtje automatike te te dhenave, fikje automatike, BMI
- Ruajte te dhenash ,ndryshim ,kalim ne njesi matje lbs/kg ,BMI

26-Aspirator Neonat

- Te jete I pershtatshem per infant
- Te shoqerohet me te pakten 2 koka silikonit.

27 - Inkubator Bebe

- Inkubator spitalor per te sapolindur dhe te lindur prematur.
- Pajisur me sistem kontrolli me mikroprocesor
- Kontrollon dhe monitoron ne menyre automatike gjate gjithë kohes: temperaturën e ajrit dhe te lekures, perqendrimin e oksigjenit dhe te lageshtise relative.
- I pajisur me panel kontrolli me ekran LED te pakten 9'' me ngjyra, per te vizualizuar parametrat e kontrollit
- Pajisur me peshore te integruar
- Vizualizim i vlerave aktuale dhe vlerave te vendosura te temperatures se ajrit, temperatures se lekures, lageshtise relative dhe perqendrimit te oksigjenit. Vizualizim i trendit grafik te parametrave te kontrollit.
- Alarmi visual dhe akustik:
- Pajisur me sisteme alarmi vizual dhe akustik per parametrat e matur
- Struktura e perbere nga te pakten 2 porta hyrese, 4 porta manipulimi.
- Pajisur me mbajtese per kaseta x-ray
- Funkcion automatik te kompensimit te temperatures ne momentin kur hapet nje nga portat hyrese te inkubatorit
- Komandim elektronik i kendit te shtratit nga paneli i komandimit, tredelenburg dhe anti-tredelenburg ne 12°
- Sistemi duhet te jete i mbeshtetur ne 4 rrota dy prej te cilave duhet te jene te pajisura me frena.
- Kontrolli i temperatures:
- Ajer, Servo control ne diapazonin: 20-37°C me rregullim 0.1°C dhe 37.1- 39.0 °C me rregullim 0.1°C
- Kontroll i temperatures se lekures: Servo control, diapazoni: 34-37°C me rregullim 0.1°C dhe 37.1- 39.0 °C me rregullim 0.1°C
- Kontroll i lageshtise: 40-95% ne 1% Inkrementim
- Diapazoni tregues per lageshtine: 10-99%
- Kontroll i Oksigjenit: 22-75%
- Diapazoni tregues per perqendrimin e oksigjenit: 10 % - 100%
- Niveli i Zhurmes brenda inkubatorit me pak se 38 dB
- Te kete nje strukture per montimin e monitoreve, pajisjeve dhe aksesoreve
- Te jete i pajisur me nje set sensoresh per temperaturën e lekures.
- Te furnizohet sebashku me konektoret e oksigjenit per neonate dhe bebe premature.

28-Blanket fototerapie

- Paisje per trajtimin fototerapik te te porsalindurit, lehtesisht e tansportueshme, teknologji LED e gjeneratorit te drites me fibra optike.
- Te jete i pajisur me dyshek me fibra-optike, me mbulesë mbeshtjellese te bute, me sipërfaqe te emetimit te drites afersisht 25x30cm te lidhur me gjeneratorin e drites me kabell optik .
- Diapazoni i rrazatimit optic brenda diapazonit: 430-490nm.

- Gjeneratori i drites LED te jete lehtesisht i montueshem ne stativ.
- Ushqimi: AC: 230 V~ 50/60 Hz

29-Kaska HOOD

- Set prej tre kapash oksigjeni me madhesi te ndryshme
- Materiali plastik
- 3 dimensione te ndryshme per te porsalindur, pediatrik dhe adult
- Te jene te pajisura me konektore per oksigjenin

30-Aparat blender ajer/O2

- I tipit manual me flowmeter
- Te mbaje fluks maksimal te pakten 40 litra/min
- Saktesia: +/- 3%
- Me rregullim manual te FIO2: 0.21 deri ne 1.0

31-PUAR

- Materjal gome
- Kapaciteti: 200-250 ml
- Te shoqerohet me aplikator

32-Nebulizator (aerosol) per neonat

- Nebulizator Profesional per perdorim spitalor
- Presion Max.: 350 kPa
- Niveli i zhurmës: 60 dBA
- Presion operativ: 0-130 kPa
- Sasia e ajrit të qarkulluar: 15 l/min
- Do shoqerohet me aksesoret e meposhtem:
- Maska e hundës (polypropylene)
- Maska e gojës (polypropylene) me valvul (silikoni);
- Maskë për fëmijë

33-Laringoskop adult

- Me bateri dhe lamat Celik Inoksi modeli Miller 0, 1, 2 dhe te autoklavueshme
- Te jete me doreze metalike me bateri
- Te jete me llampa LED

34-Laringoskop neonatal

- Me bateri dhe lamat Celik Inoksi modeli Miller 0 dhe te autoklavueshme
- Te jete me doreze metalike me bateri
- Te jete me llampa LED

35-Bilirubinometer Transkutan

- Per matje transkutane te bilirubines pa cpim (jo invazive)
- Te jete i pershratshem per te matur ne te gjitha llojet e lekurave
- Diapazoni i matjes afersisht 0-20 mg/dl

- Sistemi te afishoj ne ekran vlerat e matjes ne kohe reale
- Sistemi te kete mundesi te perdoren ne paciente menjehere pas lindjes
- Sistemi te funksionoj me bateri me kohe te gjate
- Sistemi te funksionoj pa kerkuar materiale konsumi per matje
- Perdorim i lehte dhe matje e shpejte

36-Shtrat Reanimacioni

- Lartesi e rregullueshme ne menyre elektrike afersisht 50-80cm
- Seksionet e shpines i rregullueshem ne menyre elektrike ne kendet 0°-60°
- Seksioni i kembeve i rregullueshem ne menyre elektrike kendet 0°- 20°
- Komandim elektrik tredelenburg dhe i kundert tredelenburg ne kendet 0°-15°
- Gjatesia e perafert: 220 cm
- Gjeresia e perafert: 100 cm
- Rrota me frena dhe diameter minimal 15cm
- Mbrojtese anesore dhe Mbrojtese ndaj goditjeve per pjesen ballore dhe fundore
- Platforme e dyshekut me material ABS me dimensione te peraferta 190x85cm
- Te perfshihet dyshek me dimensione te pershtatshme
- Kapaciteti maksimal ingarkeses: 200 kg
- Struktura metali e lyer me boje elektrostatiqe
- Shufer IV, Bateri per back-up e karikueshme
- Buton me funksion kyceje
- Panele kontrolli për pacientin dhe stafin mjekesor
- Furnizimi me energji VAC 220-240/50Hz

37-Shtrat Bebi

- Te jete me material plastik, antibacterial, transparent dhe portable.
- Levizjet Trendelenburg dhe reverse trendelenburg te pakten -14 deri +14 grade
- Struktura mbajtese te jete konstrukcion celiku anti korrozioneve
- Te jete I pajisur me rrota, 2 prej te cilave me frena
- Gjatesia afersisht 85 cm
- Me dyshek per bebe dhe me veshje rezistente ndaj lengjeve

38-Shtrat Pacienti

- Kapacitet mbajtes deri në 180 kg
- Platforma e dyshekut me 2 seksione:
- Pjesa e kokës ka aftësinë të lëvizë në disa opsione
- Mekanizëm rregullues i lartësisë në pjesën e kokës sipas dimensioneve të shtratit
- Dyshek me cilësi të lartë ne te gjithë shtratin i veshur me mbulesë të qëndrueshme vinylex, e cila është rezistente ndaj nxehtesise, antibakteriale dhe lahet.
- Rregullimi manual i mbështetëses së kokës në pozicione të ndryshme.
- Mbajtës universal i rrotullës së letrës (në pjesën e kokës ose në fund të shtratit sipas kërkesës).
- Kornizë metalike e veshur me pluhur elektrostatiqe.

- Përmasat: 600 X 1750 X 750 mm. (Gjer x L x H).
- Përmasat e seksionit fiks: 128 x 60 x 5,5 cm.
- Kornizë e shtratit të sipërm me profile katrore 40x40ml, trashësi 1,5 mm, e bardhë elektrostatische e pikturuar e pjekur në 180 ° C
- Katër baza këmbësh me profile katrore 40x40ml, trashësia 1.5 mm, elektrostatische e bardhë e pjekur në 180 ° C, gjatësia 12cm
- Katër këmbë shtrati me profile katrore 35x35ml, trashësia 1,35 mm, elektrostatische e bardhë e pjekur në 180 ° C, pjesa e dukshme e këmbës prej çeliku inox gjatësia e saj 54cm
- Seksioni i kokës Përmasat e dyshekut: 55cm x 60 cm x 12cm
- Mbajtëse letre prej çeliku inox, me diametër 25 mm dhe trashësi 1,35

39-Shtrat lindje obsetrike

- Shtrat lindje dhe procedura obstetrikale
- E ndare ne tre seksione: shpina, ndenjesja dhe kembet
- Me tre motore per rregullim elektronik te lartesisë, shpines dhe pozicioneve
- Tredenburg/Reverse Tredenburg
- Komandim nga nje panel kontrolli dhe/ose telekomande
- Pjesa e kembeve e zmontueshme lehtesisht
- Tredenburg / Reverse Trendenburg
- Dyshek me tre seksione, me materiale antimikrobiale, rezistente ndaj ujit, te padjegeshme, te respirueshem, dhe lehtesisht te pastrueshem
- Bazamenti / platforma e dyshekut prej materiali ABS
- Shina anesore (te zmontueshme) prej celiku inox ne seksionin e ndenjeses, destinuar per montim aksesoresh.
- Pjesa e shtrirje (dysheku) i mbushur me shkume-gome per te ndjekur formen anatomike te trupit.
- Amortizatore goditjesh gjate levizjeve
- Lartesia e shtratit e rregullueshme ne diapazonin 70 deri 85 cm
- Siperfaqja e krevatit; gjatesia min 185 cm, gjeresia min 80 cm
- Seksioni i shpines i rregullueshem nga 0 ne 70 deg.
- Tredenburg/Reverse Tredenburg i rregullueshem deri ne rreth +/- 13 deg
- Pesha mbajtëse: 200 kg ± 10%
- Aksesore: Mbajtëse kembesh (1 cift), me veshje materiali te gomuar, me lidhese per fiksime kembesh, me konstrukcion me cerniere sferike per pozicionim kendor te rregullueshem, dhe lartesi te rregullueshme, Mbajtëse anesore te pacientit (1 cift); Bacinele inoksi me fiksuesin perkates (1 cope);

40-Shtrat Ekzaminimi Gjinekologjik

- Shtrat Ekzaminimi gjinekologjik me 3 ndarje
- Mbeshtetësja e kokës dhe kembeve te jete e rregullueshme
- Permasat afersisht 60x180x80cm dhe kapaciteti mbajtes jo me pak se 220 kg
- Mbuluar me lekure sintetike ne pjesen e jashtme, lehtesisht e pastrueshme dhe qe duron nxehtesine
- Strukture metalike e kromuar ne te kater kembet

- Me mbajtese kembesh dhe bachinele si dhe mbajtese letre ne pjesen e kokes.

41- Shtrat Vizite

- Shtrat vizitash me skelet inoksi me përmasa jo me te vogla se (180*57* h73cm pesha min 100kg)
- me dy pjesë: pjesa shpinore e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e paisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe të lashëm, e kornizuar, e pajisur me 4 këmbë inoksi, e pajisur në fund të shtratit me mbajtësen e letrës rulo universal.

42-Stativ

- Stativ Inoksi me bazament me 5 rrota
- I gjithi me material inoksi
- Me mbajtese serumi inoksi per 4 vende
- Me rregullim lartesis dhe me fiksues
- Te jete rezistent ndaj dezinfektanteve spitalor

43-Barrele spitalore

- Material alumini ose ekuivalent me 4 rrota universal.
- Siperfaqja e barreles kundra ujit, me mbeshtetese shpine te rregullueshme, me rrota me frena,
- Pesha mbajtese te pakten 100 kg.
- Mbajtese ne te kater anet e barreles.
- Karroce me rrota

44-Karroce spitalore per pacientet

- Karroca duhet ta kete pjesen e karriges se palosshme.
- Struktura duhet te jete çeliku e kromuar dhe e pajisur me Xhep të pasmë.
- Duhet te kete sistem frenimi (të dy rrotat) dhe mbështetëse e lëvizshme e pjeses se këmbëve.
- Kapaciteti mbajtes se pakten 100 kg.

45-Stol me 1 shkalle per shtreter obsetrik

- Stoli te jete me 1 shkalle rezistent nga nxehtesia dhe kundra ujit.
- Te kete konstrukcion alumini
- Permasat e peraferta: 40 x 51 x h 25 cm

46-Aerosteril

- Sterilizator me ajer te thate
- Sistem elektronik I kontrollit te temperatures dhe kohes
- Struktura e brendshme dhe e jashtme teresisht celik inoksi I pa osidueshem
- Dera e pajsijes e siguruar me celes
- Me ventilim te forcuar.

- Te kete mundesi te punoj me programim te kohes 0-250 minuta ose ne menyre te vazhdueshme.
- Te mund te arrije temperature te pakten 200 grad
- Te jete e pajisur me thermostat sigurie
- Ushqimi: AC: 230 V~ 50/60 Hz

47-Set veglash mjekimi

- Forceps Thumb 16 cm
- Spekul vaginal Cusco I vogel
- Spekul vaginal Cusco I mesem
- Spekul vaginal Cusco I madh
- MBajtese instrumentash 150 ml
- Forceps TOE I drejte 14 cm
- Forceps TOE I drejte 18 cm
- Gershere Episiotomie 14 cm
- Gershere umelikale 10.5 cm
- Forceps Kocher I drejte 16 cm
- Forceps Kocher I drejte 18 cm
- Forceps Kocher I harkuar 16 cm
- Bacinele 20 cm dhe 25 cm
- Forceps me dhembe: 1x2 - 14 cm
- Forceps Museux Vulsellum 8 mm e drejte 24 cm
- Gershere per suture 15 cm
- Gershere Mayo e drejte 15 cm
- Gershere operimi e mprehte dhe e drejte 15 cm
- Gershere operimi e mprehte dhe e harkuar 15 cm
- Mbajtese gjilpere Mayo Hegar 18 cm
- Forceps dilatimi Rampley e drejte 18 cm
- Forceps dilatimi Rampley e drejte 24 cm
- Spekul vaginal Sims I vogel
- Spekul vaginal Sims I mesem
- Spekul vaginal Sims I madh
- Bacinele instrumentash drejtkendeshe 45x30x6.2 cm

48- Spekulum

- Materjali te jete celik inoksi I paoksidueshem
- Me permasa: small 75 x 32 mm, medium 85 x 35 mm, large 100 x 37 mm

49-Cistine e madhe

- Materjali te jete celik inoksi AISI 304
- Me permasa: 280 x 141 x 40 mm
- Kapaciteti mbajtes: 1600 ml
- E autoklavueshme ne 121°C

50-Cistine e mesme

- Materjali te jete celik inoksi AISI 304
- Me permasa: 254x141xh 33 mm
- Kapaciteti mbajtes: 750 ml
- E autoklavueshme ne 121°C

51-Cistine e vogel

- Materjali te jete celik inoksi AISI 304
- Me permasa: 207x128xh 33 mm
- Kapaciteti mbajtes: 480 ml
- E autoklavueshme ne 121°C

52-Valvula gjinekologjike

- Me Madhesi dhe gjatesi te ndryshme
- Afersisht: 70mm, 80mm, 90mm, 105mm, 105mm, 110mm, 110mm, 135mm

53-Hysterosalpinografi

- Te jete sipas metodologjise se Prof. Dr. Schultze.
- Manometri me diapason: 0 ne 200 mm Hg me hap 10 mm Hg
- Te jete me material te kromuar
- Shkalla te kete mundesi te lexohet edhe ne erresire
- Te jete me dalje Luer-lock
- Te perfshije te pakten 3 masa te ndryshme te pjeses konike prej materiali te kromuar, mbajtesi per te pakten 2 forcepsa uterusi. Nje shiringe qelsi dhe kromi te pakten 20 ml dhe kutine perkatese.

54-Pistoleta per marrje biopsie

- Marres biopsie I modelit KEVORKIAN me gjatesi 20 cm
- Marres biopsie I modelit Tishler I vogel, I drejte me gjatesi 25 cm
- Marres biopsie I modelit Tishler, I drejte me gjatesi 25 cm

55-Elektrocauter (njesia dhe ansat)

- Elektrobisturi me dy dalje monopolare dhe nje dalje bipolare.
- Diapazoni i fuqise: te pakten 300W
- Te kryeje procedura te endoskopise bipolare ne solucion saline.
- Mundesi memorizimi te pakten 9 programe
- Mundesi kontrolli me celes kembe dhe me elektroda dore.
- LED-bar per kontroll vizual te cilesise te kontaktit.
- Alarme vizive te ndara me ngjyra dhe akustik
- Te kete mundesi per te funksionuar edhe me gaz Argoni dhe me aspirator tymi
- Ne perputhje me standartet IEC 60601-1 , EN 60601-1 dhe IEC 60601-2-2
- Mrojtje e Klasit te pare te shkalles CF

- Aksesoret: 1x celes pedal-kembe, 1x Pllake tokzimi neutrale gome,shumepedorimshe. 1x Elektrode thike monopolare, 1x elektrode lancet e drejte (Needle Shaft electrode). 1x Pince diatermie. 1x Elektrode me tel te harkuar (Loop electrode).
- Te perفشihen nga 1 set shtese elektrodash, Elektrode thike monopolare, 1x elektrode lancet e drejte, 1x Elektrode me tel te harkuar (Loop electrode).

56- Aborcang me qafe

- Pince per abort, e drejte me nofulla afersisht 12 mm dhe gjatesi afersisht 25 cm

57-Myzo

- Te jete me gjatesi afersisht 8 mm dhe e drejte afersisht - 24 cm

58- Tavoline mobile (karroca) per pergatitjen e terapise

- Tavolinë pune, e pajisur me dy sirtarë (47x30x12 cm) nga secila anë, për të punuar në të dy anët njeheresh.
- Me kornize celik inoxi AISI 304 me structure katrore tubulare.
- Pjesa e sipërme e perbere nga celik inoxi te lemuar.
- E montuar ne 4 rrota me diameter 100 mm dhe 2 frena.
- Peshë e perafert 50 kg si dhe permasa 120 x 70 x h 95 cm

59- Tavoline mobile (karroca) per pajisjet kirurgjikale

Raftet me mbështetëse në të katër anët. Doreza e shtytjes. Montuar në rrotulla 80 mm.

- Struktura totale prej celik inoxi
- Me doreze per shtyrje
- E pajisur me 2 rafte
- Me dimensione: 60 x 40 x 80 h cm
- Me kater rrota me diameter prej 80 mm.

60- Tavoline mobile (karroca) per medikamente dhe materjale mjekesore

- Tavoline mobile alumini.
- Te jete I pajisur me 2 rafte te bardha me trashesi 18 mm e konturuar me PVC ngjyre te erret.
- Me mbajtese ne te dyja anet laterale te cilat ndihmojne per transportin e tavolines mobile
- Te jete I pajisur me 4 rrota me materjal nylon me diameter 80mm.
- Kapaciteti maksimal I mbajtjes jo me pak se 40 kg.
- Permasat e peraferta: 60 x 40 x h 77 cm
- Te jete e lehte per tu levizur dhe me peshe jo me te madhe se 13 kg.

61- Stol Kirurgjikal

- Stoli te jete I pajisur me mbeshtetese per kurrizin.
- Levizja e rregullueshme
- Te jete I pajisur me 5 rrota

62-Set hysteroskopie

- Hysteroskopi 2.9 mm 0° me rezolucion te larte, te jete me Sistem optik me cilësi të lartë, me veshje (anti-reflektues)
- Xham shumë refraktues për dhënien optimale të ngjyrave edhe kur imazhi zmadhohet
- Te kete Fusha me rezolucion të lartë, xhami i mbuluar me safir në të dy skajet, te jete ne forme Koni për të mbledhur dritë nga kablo
- Elementi I punes: BIPOLAR pasiv me kanal 18.5 CH dhe me kapje Easy lock
- Elektroda me hark, e drejte me diameter 17.5 CH per Histeroskopin e mesiperm
- Hysteroskopi Ø 4.0 mm, 12° HM HD 4 mm

63 – Kolposkop

- Kolposkop te jete I pershtatshem per ekzaminime gjinekologjike me dizajn ergonomik dhe i lehte ne perdorim.
- Okularet dhe lentet e objektivit duhet te jene te zevendesueshme.
- Duhet te kete Imazh te paster me detaje me rezolucion te larte dhe ngjyra natyrale me optike apokromatike
- Ndricim me rreze paralele per ndricim me te mire te fushes vizuale
- Duhet te kete zmadhim me nivele te ndryshme, me vezhgim te pergjithshem ne nivele te uleta dhe me dallim te qarte te detajeve ne nivele te larta.
- Me karrel mbajtes me diameter rreth 65 cm me 5 rrota per transport te lehte dhe te qendrueshem.
- Te kete mundesi shtimi te adaptoreve foto dhe video per kamera dixhitale ose endoskopike per te mundesuar dokumentimin e diagnostikimeve mjekesore si dhe te sistemit lazer per te mundesuar heqjen e indeve te demtuara.
- Te jete I perbere prej materiali metalik per te siguruar jetegjatesi.
- Kolposkopi duhet te jete me imazhe tre dimensionale dhe me thellesi fushe te madhe per nje diagnoze te suksesshme.
- Me ndricim te integruar LED per jetegjatesi te llampes
- Distanca e punes/ Objektiv : 250mm ose 300mm standard.
- Fokusimi I imet: 12mm me objektiv fokusimi f=250 mm dhe f=300 mm, 40mm manual dhe 40mm I motorizuar
- Tubat Binokulare: Tuba te drejte f=125 mm, Tuba te pjerret f=125 mm 45°
- Okularet: Cift me kend te gjere me diopter WF 16 x V ose WF 20 x V
- Zmadhim minimumi deri ne 21X me fushe pamje me diameter minimal 8 mm
- Gjatesia totale e kraheve minimum 110 cm dhe lartesi jo me e vogel se 130 cm

64- Monitor

- Monitori te jete mjekesor dhe te supertoj afersisht 1.07 billion ngyra.
- Monitori duhet te jete te pakten 21.3" dhe me rezolucion te larte (2048X1536)
- Monitori duhet te I pershtatshem per pajisje mjekesore dhe I perstatshem edhe per sistemin PACS
- Monitori duhet te jete I kalibruar sipas metodes DICOM dhe te ofroje saktesi maksimale te detajeve dhe imazheve mjekesore.

- Niveli ndricimit te jete jo me pak se 1000cd/m2 Typ dhe I kontrastit 1500:1 Typ.
- Kendi I imazhit te jete afersisht 178°
- MTBF: > 50,000Hours

Lot 2 - F.V paisje hotelerie për Maternitetin e Beratit”

1. Banak për reception

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 250 x 70 x 110 cm

Banaku përbëhet nga syprina e madhe 250 x 70 cm mbi të cilën qendron syprina e vogël në lartësinë 38 cm me dimensione 250 x 30 cm. E gjithë mobilja do të ndërtohet me material melamine 25 mm. Ato kanë veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Anësorja dhe ballorja e banakut do të ndërtohet po me të njëjtin material. Në të njëjtin plan, në lartësinë 38 cm nga syprina e madhe vendoset syprina e vogël me dimensione 30 x 250 cm, e cila është pjesë e mbështetjes së klientit. Të gjithë elementët e banakut të receptionit të jenë të borduara me material plastik PVC. Pjesë e receptionit është dhe një sirtarierë e lëvizshme, specifikimet teknike të së cilës i kemi dhënë më vete. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

2. Dollap metalik me dyer

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 92 x 40 x 195 cm

Dollap metalik me dyer duhet të ketë strukturë prej çeliku të lyer që ti rezistojë korozionit dhe përkuljes. Dollapi duhet të sigurojë mbyllje me çelës. Hapësira e brendshme e dollapit ndahet në 5 hapësira. Sergjenët ndarës duhet të kenë përshtatje lartësie jo më shumë se 30 mm dhe të kenë aftësi mbajtëse jo më pak se 50 kg. Këmbët e dollapit duhet të kenë mundësi nivelimi. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

3. Dollap për dosje dy kanatësh

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 80 x 45 x 180 cm

Skeleti dhe kanatet duhet të jenë prej materiali melaminë me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Sergjenët do jenë prej materiali melaminë me trashësi 2.5 cm. Materiali të ketë veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Xokula do të jetë 8 cm e lartë dhe prej të njëjtit material. Bordet anësore të skeletit, sergjenëve dhe kanateve të jenë të veshura (borduara) me material plastik PVC. Kanatet të mbyllen me celes. Pjesa e brendshme të ndahet në 5 (pesë)hapësira me sergjenë me mundësi regjistrimi sipas nevojës. Dorezat e kanateve dhe aksesoret e përdorur të jenë cilësorë. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

4. Dollap rrobash për zyra (një kanat)

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 45 x 55 x 200 cm

Skeleti dhe kanati duhet të jenë prej materiali melaminëme trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Materiali të ketë veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të dukshme të skeletit dhe kanatit të jenë borduara me material plastik PVC. Kanati të kete mbyllje me çeles. Në pjesën e brendshme të ketë tub për varjen e rrobave dhe ndarje qe formojne dy hapësira ne pjesen e poshme. Të jetë i paisur me tapa plastike kunder gervishtjes.Dorezat e kanatit dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

5. Etazhier për zyrë e vecantë

Përmasat(gjerësi x thellësi x lartësi): 530 x 35 x 125 cm

Syprina e etazhierit të jetë prejmaterial melamineme spesor 18-25mm. Kapakët duhet të jenë xhami të temperuar me telajo (kornize) melamine.Etazhierit ndahet në dy hapësira nëpërmjet sergjenit i cili ka spesor 25 mm.Faqet (bordet) anësore tëmaterialit të jenë të borduara me material plastik PVC. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

6. Karrike për salla konferencash

Karriket të jenë dizenuar me një stil modern me skelet metalik prej tubash çeliku me profil oval30x15 mm dhe spesor jo me te vogel se 1.3mmdhe lyster me boje elektrostatische. Shpinorja dhe ndenjësja në pjesën e brendshme kanë një kompesatë të kurbuar. Karriget kane krahe ne dy anet e saj dhe ne krahun e djathte vendoset nje tavoline e vogel, e levizshme, per te shkruar.Ndenjesja dhe shpinorjamontohen në skeletin metalik me vida. Shpinorja dhe ndenjësja kanë mbushje gome sintetike me densitet të lartë. Tapiceria të jetë në stof të cilësisë së parë ose lëkure ekologjike. Karrigia të projektohet në mënyrë që të minimizojnë rrezikun e dëmtimit të përdoruesve.Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

7. Komodina dyshe (ushtari)

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 60 x 40 x 80 cm

Materiali i përdorur do jetë melamine me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të elementëve përbërës të jenë të veshur me material plastik PVC. Ato duhet të jenë të paisura me një sirtar në pjesën e sipërme dhe pjesën mbajtëse të rrobave që mbyllet me dy kapakë. Komodina qëndron mbi 4 këmbë metalike me lartësi 5 cm nga toka dhe të paisura me mekanizëm regjistruar. Dorezat e kanateve dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë. Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

8. Krevat tek

Përmasat (gjatësi x gjerësi): 190 x 90 cm

Materiali i përdorur do jetë melamine me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të elementëve përbërës të jenë të rrethuaraveshura me material plastik PVC. Koka e krevatit te jete me permasa 80 x 90 cm,

ndersa fundi me permasa 40 x 90 cm). Krevati do te jete i pajisur me radice druri te stazhonuar per mbajtjen e dyshekut. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

9. Poltron pritje dyvendësh (kolltuk dyvendësh)

Përmasat: Gjerësia: 186 cm, Thellësia: 95 cm, Lartësia: 94 cm

Të jetë me skelet druri. Të jetë i dizenuar me linja të drejta të stilit modern. Me tapiceri prej lëkure ekologjike të një cilësie të lartë. Sfungjeri i përdorur të jetë cilësor. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

10. Poltron pritje njëvendësh (kolltuk njëvendësh)

Përmasat: Gjerësia: 92 cm, Thellësia: 89 cm, Lartësia: 84 cm

Të jetë me skelet druri. Të jetë i dizenuar me linja të drejta të stilit modern. Me tapiceri prej lëkure ekologjike të një cilësie të lartë. Sfungjeri i përdorur të jetë cilësor. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

11. Tavolinë e vecantë për sallë mbledhjesh

Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 350 x 170 x 75 cm

Syprina melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me plane të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës (syprinës) me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Syprina e tavolinës përbëhet nga 4 elementë. Dy elementë me permasa 180 x 80 cm që vendosen paralalish me njëri tjetrin duke lënë një hapësirë 10 cm midis tyre. Dy elementët e tjerë janë në permasa 170 x 85 cm, dhe janë në formë gjysmërrethi. Duke u vendosur përballë njëra tjetrës, në dy anët e ngushta të dy elementëve të parë i japin tavolinës një pamje ovale. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

12. Tavolinë mence

Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 80 x 80 x 75 cm

Syprina melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të syprinës të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Mbështetet në 4 këmbë prej çeliku të cilat janë të paisura me këmbëza niveluese. Ato lidhen me njëra tjetrën me traversa të po të njëjtit material. Të gjitha pjesët metalike janë të lyera me bojë elektrostatiqe me qëndrueshmëri të lartë ndaj ndryshkjes dhe gërvishtjeve. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen

gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

13. Tavolinë mesi

Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 110 x 55 x 45 cm

Materiali i përdorur do të jetë MDF e rimesuar. Syprina në pamjen ballore të saj do të jetë 10 cm. Këmbët e tavolinës përbëhen nga i njëjti material me atë të suprinës dhe janë të përmasave 10 x 10 x 35 cm. Ato montohen në skajet e suprinës së tavolinës dhe duhet të garantojnë një qëndrueshmëri të lartë, sidomos në pozicionin rrëshqitës. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

14. Tavolinë pune e thjeshtë

Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 140 x 80 x 75 cm

Syprina melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Në pjesën e brendshme në njërin krah ndodhet posti i tastierës e fiksuar me shina rrëshqitëse, në krahun tjetër ndodhen dy sirtare me gjerësi 45 cm ku sirtari i parë të jetë i mbyllur me çeles. Montimi i tastierës duhet të jetë i thjeshtë dhe me mundësi zgjedhje të krahut të punës. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kablllove nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

15. Varëse rrobash + mbajtëse çadrash (e levizshme)

Struktura duhet të ketë një bazament rrethor me diameter jo më të vogël se 30 cm, i rëndë dhe solid. Të ketë 8 vende për të varur rroba dhe një vend bashkangjitur për çadra. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

16. Varëse rrobash e fiksuar në mur

Përmasat (gjerësi x lartësi): 70 x 90 cm

Materiali i përdorur do të jetë melaminë me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të elementëve përbërës të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Në mënyrë simetrike do të vendosen 4-5 varëse portmontoje në formë zig-zag. Në pjesën e sipërme të jetë e paisur me dy piastra që do shërbejnë për fiksimin në mur. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

17. Pasqyrë muri për tualet

Përmasa 80 x 60 cm, të jenë me korniza druri. Xhami i pasqyres të jetë i cilesise së lartë. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës. Montimi sipas kërkesave të AK-ve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.


18. Karrige statike pa krahë

Karriget të jenë dizenuar me një stil modern. Thellësia e ulëses e përshtatshme për përdorues të rritur. Skeleti përbëhet prej një tubi petashuq ovale 30 x 15 mm me spesor jo me te vogel se 1.3 mm, i cili përshkon shpinoren në dy anët e saj dhe ndenjësën. Montohen në skeletin metalik me vida. Me mbushje gome sintetike me densitet të lartë. Lyerja me boje elektrostatische. Tapiceria të jetë lëkurë ekologjike. Karrigia të projektohet në mënyrë që të minimizojnë rrezikun e dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.



19. Ekspozitorë

Dy panele druri të lehtë (paulania, ose zdrukthi), orientimi horizontal, me përmasa secila 90 x 220 cm, të kapura në brinjen e ngushte me 2-3 mentesha metalike estetike, dhe të montuara me hapje/kend 15 gradë me njëra-tjetrën, dhe të lidhura në bazament për qendrueshmeri. Secili panel ka te montuar 4 xhepa horizontale (90 cm te gjate dhe 12 cm te gjere) te vendosur me 50 cm largesi njeri nga tjetri gjate gjithë lartesisë se panelit. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

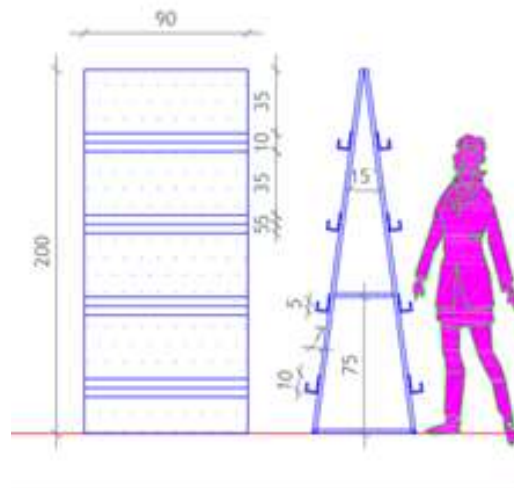

20. Rafte metalike

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 100 x 60 x 250 cm

Specifikimet teknike për raftet metalike janë:

- Skeleritë metalike të jenë prodhime cilësore dhe solide me material hekuri “L”.
- Materiali “L”, të jenë prej hekuri cilësi e parë, me spesor jo më të vogël se 4 mm dhe gjerësi 40 mm.
- Këmbët të jenë të jenë 12 cm nga toka, ndarset (sergjenet) të jene çdo 50 cm të salduara në mënyrë që të mbajnë pesha të mëdha.
- Shtresat e sergjenët të jenë prej llamarine me trashësi jo më pak se 1.2 mm e cilësi e parë, e punuar me forma që të mbajnë peshën e shpërndarë në mënyrë uniforme në të gjithë sergjenin, jo më pak se 120 kg.
- Sergjenët të jenë me përmasa 100 x 50 cm x 60 cm thellesi.
- Raftet të realizohen sipas përmasave të kërkuara, dhe te kene vrima të hapura ne gjithe lartesine e trupit të kembeve për te krijuar mundësitë që te lidhen me njëri – tjetrin me vida dhe bulona.
- Ngjyra e rafteve të jetë gri, lyerja fillimisht me boje kundra ndryshkjes dhe më pas dy duar me bojë zmalto.
- Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

21. Stola pritje dy vendeshe me gjatesi*lartesi*lartesi 110*40*77

Stola * 2 vende-(Set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 2 ndenjese të lidhura bashkë me gjatesi 48 cm sejcila e g te stolit 110 cm, bashke me ndarjet midis ndenjeseve me material inoks/kromuar me ndenjese inoks/kromuar të l metalizato, shpinore me material inoks/kromuar te lyera metalizato me mbajtese anesore. Materiali duket te jete me vrima te vogla simetrike ne gjithe siperfaqen e ndenjeseve.) Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Gilesia dhe materiali si ne foton me poshte tek Nr. 22

22. Stola pritje tre vendeshe me gjatesi*lartesi*lartesi 174*40*77

Stola * 3 vende (Set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 ndenjese të lidhura bashkë me gjatesi 48 cm sejcila e g te stolit 174 cm, bashke me ndarjet midis ndenjeseve me material inoks/kromuar me ndenjese inoks/kromuar të l metalizato, shpinore me material inoks/kromuar te lyera metalizato me mbajtese anesore. Materiali duket te jete me vrima te vogla simetrike ne gjithe siperfaqen e ndenjeseve). Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.



23. Perde Rroller Komplet (permasat sipas tabelës me perde e mekanizem)

Perde Rroller Komplet (Grila Veneciane) E gjithë sipërfaqja do të përbehet nga 68 mekanizma roller për hapjen mbylljen e grilave anësore me sipërfaqe të elementit përberës gjatësi kanë lartësi dhe gjëresi 12.5 hapësirat - dritare. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.



24. Set Tualeti komplet

Set në tualet (Pasqyre 60*40 cm xhami çilesorë, mbajtëse peshqirash, mbajtëse sapuni, mbajtëse furçe dhembesh, leter higjienike). Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

25. F.V. Kosha Mbeturinash Urbane ambjenti 10 liter

Kosha mbeturinash 10 liter (mbeturina, me tre këmbë të fiksuara me bulon në beton me lartësi 10 cm nga sipërfaqja 20 ristela druri me trashësi 1.5 cm, gjëresi 4 cm e gjatësi 60 cm të mberthyer me percina në dy rrathe metalike në bazament të rrumbullakët llamarine që nuk ndryshket lehtësisht. Brenda saj një kosh llamarine që nuk ndryshket me permasat me diametër 25 cm me lartësi 50 cm me dy veshe metalike.) Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.



26. Kosha Inoksi per ambjentin e jashtem, cigarete, 8 liter

Kosha Inoksi per mbeturina dhe me kapak cigarete te rrumbullaket me diameter 25 cm e gjatesi 60 cm. Ngjyra ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.



27. Piktura e printuar ne pelhure me permasat gjeresi-gjatesi 120*200 cm.

Piktura Printuar ne Pelhure/Canvas I kualitetit te larte me permasa gjeresi-gjatesi 108*188. Ngjyra ekologjike. K dru I perpunuar me gjeresi-gjatesi 6 cm*120*2cope; 6*200*2cope.

28.Paravente-Perde ndarese me dy pjese, e levizshme.

Me profil metalik 20*20 me elemente me gjatesi totale 10.5 ml. Beze te padukshme me sipërfaqe 10 m2. Me ndarese simetrike te cilat bashkohen me dy mentesha dhe mbeshteten ne 6 rrota qe levizin ne kembezat). si Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.



29. Stol salle i rrumbullaket druri.

Me kater kembeza druri me gjatesi 72 cm me permasa 4*4 cm, me ndenjese me perimeter 100 cm me material trashesi 3 cm, me dy bashkuese profil te rrumbullaket 30 mm nje me perimeter 100 cm dhe nje me perimeter Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.



30. Stol Salle katror i larte druri.

Me kater kembeza druri me gjatesi 72 cm me permasa 4*4 cm, me ndenjese katrore me brinjet 31*31 cm me n druri me trashesi 3 cm, me dy bashkuese te perbere nga 8 binare 3*3 cm me gjatesi 31 cm. Ngjyrat janë të nd përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.



31. Stol Salle katror i mesem druri.

Me kater kembeza druri me gjatesi 44 cm me permasa 4*4 cm, me ndenjese me brinjet 31*31 cm me material trashesi 3 cm, me dy bashkuese te perbere nga 8 binare 3*3 cm me gjatesi 31 cm. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.



32. Tavolina bango mermeri salle Materniteti permasat (Gjatesi*Gjeresi*Lartesi) 320*40*67

Bangua e perbere nga mermer me trashesi 4 cm e sipërfaqe 1.3 m².

Sipërfaqja e heles me kende 40*40 me gjatesi 7.2 ml

Kembet te jene profil 40 *40 te cilat do te jene 6 kembe * 67 cm

33. Tavoline bango mermeri salle Materniteti(Gjatesi*Gjeresi*Lartesi) 300*40*67

Bangua e perbere nga mermer me trashesi 4 cm me sipërfaqe 1.3 m².

Sipërfaqja e heles me kende 40*40 me gjatesi 6.8 ml

Kembet te jene profil 40 *40 te cilat do te jene 6 kembe * 67 cm

34. Tavoline bango mermeri salle Materniteti(Gjatesi*Gjeresi*Lartesi) 850*40*67cm

Bangua e perbere nga mermer me trashesi 4 cm me sipërfaqe 3.4 m².

Sipërfaqja e heles me kende 40*40 me shtëpjesi 19 ml

Kembet te jene profil 40 *40 te cilat do te jene 14 kembe * 67 cm

35. Raft shapaksh kirurgjikale me permasat gjatesi*gjeresi*lartesi 82*33*60 cm

Kembet te perbera me tub alumin ½ polsh me gjatesi 3.1 ml i ndare ne dy elemente(kembe) 2 cope*3.1 ml elemente bashkues me gjatesi 6 cope*33 cm me nje gjatesi 3.55 ml

Mbajteset dhe bashkueset anesore perbere nga tub 34/ polsh me gjatesi 15 cope*82 cm dhe 6 cope*33 ml



36. Mbajtese legenash per larje duarsh me gjatesi*gjeresi*lartesi 100*37*80 cm

Tub inoksi ½ polsh me gjatesi 5.5 ml i ndare ne dy elemente(kembe) te njete.

Fashete inoksi 30 me gjatesi 4 ml me te cilen do pergatiten elementet e mbajtjes se legenave dhe bashkueset



37. Frigorifer

- Lloji i ftohjes me ajer
- Permasat deri ne 60*185*65
- Materiali i rafteve xham
- Paneli i kontrollit elektronik

- Klasi i energjise A+
- Mbrojtja e ushqimeve me shtrese anti-bakteriale
- Ndricim i brendshem led
- Ftohje e shpejte dhe zona freskie
- Ngjyre e bardhe ose gri



38. Shkalle Arshive Kartoteke

Me konstrukt me profil metalik te lehte 40*40 me lartesi 200 cm secila me gjashte shkalle me profil te njejte me lartesi 60 cm.Me kembeza veshur me plastike.



39. Lule Artificiale e madhe-Bambuqe



Peme artificiale, BAMBU, jeshile, 208 cm

Peme artificiale, BAMBU, jeshile me lartesi 208 cm.

40. Vazo lulesh plastike te medha gjatesi*gjeresi*lartesi 50*50*45

Vazo lulesh plastike, e bardhe, katrore, per lule ne dysHEME.



41. Lule artificiale e mesme- Bonsai



Ficus Ginseng (bonsai) v 25 l, 70

Ficus -Ginseng (bonsai) vazo 25 lartesi 70 cm.

42. Vazo lulesh balte te bardha per lule te mesme bonsai



43. F.V.Karaktere (Shkronja) per shkrim ne mur (50 karaktere), me ngjyre te zeze, me per
lartesi*gjeresi 11*6 cm

**“ Nena mban duart e femijes per pak
dhe
zemrat pergjithmone ”**

44. Korniza druri me xham me permasat gjatesi*gjeresi 50*40
Me material druri e me xham.

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Afati i garancise: 1 (nje) vit për pajisjet e mobilimit,

Afati i garancise: 1 (nje) vit për pajisjet mjekesore.

Në momentin e dorëzimit të pajisjeve, Kontraktori duhet t'a shoqërojë mallin me dokumentacionin përkatës që vërteton plotësimin e standardeve dhe specifikimeve teknike të kërkuara. Pajisjet duhet të jenë të shoqëruara me manualët e përdorimit dhe manualët e servisit/shërbimit.

Shtojca11

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

<input type="checkbox"/> Mall: Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër _____		
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Loti 1: “F.V paisje mjekesore per Maternitetin e Beratit ”.

Nr	Emertimi i pajisjeve dhe aparaturave	Njesia matese	Sasia	Cmimi Njesi pa tvsh	Cmimi Total pa tvsh
1	Tavoline Operatore- Obstetrikale dhe gjinekologjike	cope	2		
2	Makine Anestezie (set)	cope	2		
3	Llampe operatore	cope	2		
4	Llampe mobile	cope	4		
5	Llampe ekzaminimi	cope	3		
6	Llampe baktericidi	cope	5		
7	Elektrobisturi	cope	2		
8	Karrel instrumentash kirurgjikale	cope	4		
9	Pajisje aspirimi per gjinekologji	cope	3		
10	AED external me monitor	cope	1		
11	Ambu adult	cope	2		
12	Ambu neonati dhe premature	cope	3		
13	Komplet instrumentash obstetrikal	cope	10		
14	Set abrazio	cope	3		
15	Cardiotohograf I zakonshem me opsion printimi	cope	1		
16	Shiringe infuzioni elektrike	cope	2		
17	Aparat ECHO obstetrikale 2D/3D/4D	cope	1		
18	Pompe infuzioni	cope	9		
19	Pajisje per monitorim te parametrave vitale adult	cope	10		
20	Pajisje per monitorim te parametrave vitale neonat	cope	2		
21	Radiante	cope	4		

Dokumentat Standarde të Tenderit

22	Aparat fototerapie (llampe fototerapie)	cope	1		
23	Aparat CPAP	cope	1		
24	Peshore femijesh dixhitale	cope	2		
25	Peshore adulte	cope	4		
26	Aspirator neonat	cope	4		
27	Inkubator Bebe	cope	2		
28	Blanket fototerapie	cope	2		
29	Kaska HOOD	cope	2		
30	Aparat blender ajer/O2	cope	1		
31	PUAR	cope	10		
32	Nebulizator (aerosol) NEONATAL	cope	4		
33	Laringoskop adult	cope	4		
34	Laringoskop neonatal	cope	1		
35	Bilirubinometer transkutan	cope	2		
36	Shtrat reanimacioni	cope	2		
37	Shtrat bebi	cope	20		
38	Shtrat pacienti	cope	52		
39	Shtrat lindje obstetrike	cope	3		
40	Shtrat egzaminimi (vizite gjinekologjike)	cope	4		
41	Shtrat vizite	cope	11		
42	Stativ	cope	60		
43	Barrele spitalore	cope	2		
44	Karroce spitalore per pacientet	cope	5		
45	Stol me 1 shkalle per shtreter obst.	cope	43		
46	Aerosteril	cope	6		
47	Set veglash mjekimi	cope	6		
48	Speculum	cope	30		
49	Cistina te medha	cope	15		
50	Cistina te mesme	cope	10		
51	Cistina te vogla	cope	10		
52	Valvula gjinekologjike	cope	10		
53	Hysterosalpinografi	cope	1		
54	Pistoleta per marrje biopsie	cope	5		
55	Elektrocauter (njesia dhe ansat)	cope	1		
56	Aborcang me qafe	cope	10		
57	Myzo	cope	4		
58	Tavoline mobile (karroca) per pergatitjen e terapise	cope	10		

Dokumentat Standarde të Tenderit

59	Tavoline mobile (karroca) per pajisjet kirurgjikale	cope	10		
60	Tavoline mobile (karroca) per medikamente dhe materjale mjekesore	cope	10		
61	Stol Kirurgjikal	cope	15		
62	Set hysteroskopie	cope	1		
63	Kolposkop	cope	1		
64	Ekran sekondar per paisje mjekesore per shfaqje imazhesh echo/kolposkopi etj...	cope	4		

Loti 2: F.V paisje hotelerie per Maternitetin e Beratit.

Nr	Emërtimi i artikujve	Njësia	Sasia	Çmimet për njësi pa TVSH	Vlera pa TVSH
1	Banak për reception Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 250 x 70 x 110 cm	Copë	1		
2	Dollap metalik me dyer Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 92 x 40 x 195 cm	Copë	41		
3	Dollap për dosje dy kanatësh Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 80 x 45 x 180 cm	Copë	2		
4	Dollap rrobash për zyra (një kanat) Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 45 x 55 x 200 cm	Copë	66		
5	Etazhier për zyrë e veçantë Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 530 x 35 x 125 cm	Copë	1		
6	Karrike për salla konferencash	Copë	12		
7	Komodina dyshe (ushtari) Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 60 x 40 x 80 cm	Copë	32		
8	Krevat tek Përmasat (gjatësi x gjerësi): 190 x 90 cm	Copë	2		

Dokumentat Standarde të Tenderit

9	Poltron pritje dyvendësh (kolltuk dyvendësh) Përmasat: Gjerësia: 186 cm, Thellësia: 95 cm, Lartësia: 94 cm	Copë	1		
10	Poltron pritje njëvendësh (kolltuk njëvendësh) Përmasat: Gjerësia: 92 cm, Thellësia: 89 cm, Lartësia: 84 cm	Copë	5		
11	Tavolinë e vecantë për sallë mbledhjesh Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 350 x 170 x 75 cm	Copë	1		
12	Tavolinë mence Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 80 x 80 x 75 cm	Copë	26		
13	Tavolinë mesi Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 110 x 55 x 45 cm	Copë	1		
14	Tavolinë pune e thjeshtë Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 140 x 80 x 75 cm	Copë	23		
15	Varëse rrobash + mbajtëse çadrash (e levizshme)	Copë	6		
16	Varëse rrobash e fiksuar në mur Përmasat (gjerësi x lartësi): 70 x 90 cm	Copë	5		
17	Pasqyrë muri për tualet Përmasa 80 x 60 cm	Copë	10		
18	Karrige statike pa krahë	Copë	95		
19	Ekspozitorë	Copë	1		
20	Raft metalik për dosje (arshivë) Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 90 x 40 x 200 cm	Copë	27		
21	Stola pritje dy vendeshe	cope	5		
22	Stola pritje tre vendeshe	cope	5		
23	F.V.Perde Rroller Komplet	m2	192		
24	Set Tualeti	set	20		
25	F.V. Kosha Mbeturinash Urbane ambjenti 10 liter	cope	2		
26	Kosha Inoksi per ambjentin e jashtem, cigarete, 8 liter	cope	6		

Dokumentat Standarde të Tenderit

27	Pikturë e printuar në pelhure me permasat gjatesi-gjatesi 120*200 cm.	cope	1		
28	Paravente-Perde ndarese me dy pjesë, e levizshme.	cope	10		
29	Stol salle i rrumbullaket druri.	cope	1		
30	Stol Salle katror i larte druri.	cope	2		
31	Stol Salle katror i mesem druri.	cope	6		
32	Tavolina bango mermeri salle Materniteti permasat (Gjatesi*Gjeresi*Lartesi) 320*40*67	cope	1		
33	Tavoline bango mermeri salle Materniteti(Gjatesi*Gjeresi*Lartesi) 300*40*67	cope	1		
34	Tavoline bango mermeri salle Materniteti(Gjatesi*Gjeresi*Lartesi) 850*40*67cm	cope	1		
35	Raft shapkash kirurgjikale me permasat gjatesi*gjeresi*lartesi 82*33*60 cm	cope	4		
36	Mbajtëse legenash për larje duarsh me gjatesi*gjeresi*lartesi 100*37*80 cm	cope	4		
37	Frigorifer	cope	4		
38	Shkalle Arkive Kartoteke	cope	2		
39	Lule Artificiale e madhe-Bambuqe	cope	8		
40	Vazo plastike të bardha lulesh të mëdha gjatesi*gjeresi*lartesi 30*30*25		8		
41	Lule artificiale e mesme-Bonsaj	cope	10		
42	Vazo lulesh balte të bardha për lule të mesme bonsai	cope	10		
43	F.V.Karakterë (Shkronja) për shkrim në mur (50 karaktere), me ngjyrë të zeze, me permasat lartesi*gjeresi 11*6 cm	cope	50		
44	Korniza druri me xham me permasat gjatesi*gjeresi 50*40	cope	40		

Numri I mekanizmave dhe siperfaqet per
cdo dritare per Perdet Rroller

Emertimi	Njesia	Sasia	gjeresi	lartesi	Siperfaqe m2
Dritare	m2	1	1.4	1.85	2.59
Dritare	m2	1	1.4	1.85	2.59
Dritare	m2	1	1.4	1.85	2.59
Dritare	m2	1	1.15	1.85	2.1275
Dritare	m2	1	1.35	1.85	2.4975
Dritare	m2	1	1.85	1.85	3.4225
Dritare	m2	1	1.2	1.8	2.16
Vetrare	m2	1	3.55	1.5	5.325
Vetrare	m2	1	3.4	1.5	5.1
Dritare	m2	1	1.65	1.85	3.0525
Dritare	m2	1	1.65	1.85	3.0525
Dritare	m2	1	1.45	1.85	2.6825
Dritare	m2	1	1.65	1.85	3.0525
Dritare	m2	1	1.45	1.85	2.6825
Dritare	m2	1	1.65	1.85	3.0525
Dritare	m2	1	1.65	1.85	3.0525
Dritare	m2	1	1.45	1.85	2.6825
Dritare	m2	1	1.45	1.85	2.6825
Dritare	m2	1	1.45	1.85	2.6825
Dritare	m2	1	1.25	1.85	2.3125
Dritare	m2	1	1.45	1.85	2.6825
Dritare	m2	1	1.45	1.85	2.6825
Dritare	m2	1	1.25	1.85	2.3125
Dritare	m2	1	1.45	1.85	2.6825
Dritare	m2	1	1.45	1.85	2.6825
Dritare	m2	1	1.65	1.85	3.0525
Dritare	m2	1	1.65	1.85	3.0525
Dritare	m2	1	1.65	1.85	3.0525
Dritare	m2	1	1.45	1.85	2.6825
Dritare	m2	1	1.25	1.85	2.3125
Dritare	m2	1	1.65	1.85	3.0525
Dritare	m2	1	1.37	2.1	2.877
Dritare	m2	1	1.35	2.1	2.835
Dritare	m2	1	1.35	2.1	2.835
Dritare	m2	1	1.23	2.1	2.583
Dritare	m2	1	1.37	2.1	2.877
Dritare	m2	1	1.37	2.1	2.877
Dritare	m2	1	0.45	2.1	0.945

Dokumentat Standarde të Tenderit

Dritare	m2	1	1.37	2.1	2.877
Dritare	m2	1	1.32	2.1	2.772
Dritare	m2	1	1.3	2.1	2.73
Dritare	m2	1	1.3	2.1	2.73
Dritare	m2	1	1.35	2.1	2.835
Dritare	m2	1	1.4	2.1	2.94
Dritare	m2	1	1.4	2.1	2.94
Dritare	m2	1	1.18	2.1	2.478
Dritare	m2	1	1.35	2.1	2.835
Dritare	m2	1	1.4	2.1	2.94
Dritare	m2	1	1.32	1.85	2.442
Dritare	m2	1	1.05	2.1	2.205
Dritare	m2	1	1.35	2.1	2.835
Dritare	m2	1	1.37	2.1	2.877
Dritare	m2	1	1.37	2.1	2.877
Dritare	m2	1	1.65	1.85	3.0525
Dritare	m2	1	1.45	1.85	2.6825
Dritare	m2	1	1.65	1.85	3.0525
Dritare	m2	1	0.86	1.85	1.591
Dritare	m2	1	1.6	1.85	2.96
Dritare	m2	1	1.6	1.85	2.96
Dritare	m2	1	1.65	1.85	3.0525
Dritare	m2	1	1.65	1.85	3.0525
Dritare	m2	1	1.25	1.8	2.25
Vetrare	m2	1	3.55	1.85	6.5675
Vetrare	m2	1	3.4	1.85	6.29
Dritare	m2	1	0.64	1.16	0.7424
Dritare	m2	1	0.64	1.16	0.7424
Dritare	m2	1	0.64	1.16	0.7424
Dritare	m2	1	0.64	1.16	0.7424
Dritare	m2	1	1.5	1.8	2.7
		69			192

Afatet e lëvrimit: Brenda 45 (dyzetepese) diteve nga data e lidhjes se kontrates.

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR⁴

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< **Emri** >

⁴ Ky njoftim duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore

Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

* * *

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
numri i NIPT-it

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
numri i NIPT-it

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
numri i NIPT-it

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

* * *

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit: _____

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomikisht më e favorshme çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatorën e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Perkatësisht për arsyt e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____/Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____/Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME Mallrat – Tender i Hapur

Neni 1: Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruarra me anë të procedurës me negociim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
- 2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi,

- tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.
- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.
- 2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikrat e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Pronësia Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtrijë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikën, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdorë për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Mallrave

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar. Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezultojnë një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.

- 7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit që siguron mallrat.

Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojin e specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilësinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimin e reklamës së shitësit (Kontraktuesit).

Neni 10: Pjesët e Këmbimit

- 10.1 Nëse është e parashikuar në kontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvruara një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë përkatëse të kontratës.
- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.

- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.
- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t'i lënë mundësi atij që të prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japë pa pagesë Autoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

Neni 11: Ambalazhimi

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe paketuar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe paketuar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

Neni 12: Testimet dhe Inspektimet

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës.
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimin.
- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

Neni 13: Kushtet e Dorëzimit

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave* botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.
- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

Neni 14 Transportimi i Mallrave

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuar në kontratë.
- 14.2 Në Autoritetin Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i dorëzojë Autoritetin Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencon në kalimin e riskut.

Neni 15: Siguracioni

- 15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruara ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave

- 16.1 Përpara pranimit, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.

- 16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

Neni 17: Garancitë

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditëve nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor s i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë Mallrat defektoze ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

Neni 18: Çmimi i Kontratës

- 18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktor.

18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin, udhëzimet, manualët dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlera e taksave dhe tarifave duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

Neni 19: Afatet e Pagesës

19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.

19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.

19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.

19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendrike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.

19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22: Forca Madhore

22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim

ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i verifikimit të rasteve të Forcës Madhore.

- 22.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor goftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 23.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë Kontraktuesin me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakord me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore::
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet

- 25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjen e Kontraktuesit.
- 25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 26: Ndryshimi i Porosisë

- 26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

- 27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.
- 28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..
- 29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 30: Nënkontraktimi

- 30.1. Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- 30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.
- 30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 31: Transferimi i të Drejtave

- 31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 32: Sigurimi i Kontratës

- 32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- 32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

Neni 33: Baza Ligjore

33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.

34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 35: Përfaqësimi i Palëve

35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.

35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 36: Lajmërimet

36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetër sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 37: Llogaritja e Afateve

37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA **Mallrat – Procedurë e Hapur**

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

- 1.1 Autoriteti Kontraktor është _____
- 1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

- 2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: _____
- _____
- _____

Neni 3: Fillimi i Zbatimit

- 3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4: Inspektimet dhe Testimet

- 4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen: _____
- _____
- _____
- _____

Neni 5: Kushtet e Dorëzimit

- 5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave do të bëhet sipas Grafikut të Lëvrimin të parashikuar në këtë kontratë.
- 5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor _____ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.

- 5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek: _____

- 5.4 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.
- 5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: _____

Neni 6: Kushtet e Pagesës

- 6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vone që të vije. Nëse nuk është specifikuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.
- 6.2 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 7. Pagesa Paraprake

- 7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.
- 7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.
- 7.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to

- 8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës

- 9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 18

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror	Institucion i Pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njesi e Qeverisjes Vendore	Tjetër
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje	Qira	Leasing	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

- 1 Fondi limit _____
2. Burimi i Financimit _____
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në **muaj** ose **ditë**

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.6 Ndarja në LOTE:

Po Jo

Nëse Po, numri i LOTEVE:

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E Hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë
etj. pikë

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po Jo

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____

Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi □ □ / □ □ / □ □ □ □

Shtojca 18/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ me Tvsh Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 20

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: *Autoriteti Kontraktor*

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqërisht).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi
Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin
e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nënshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 21

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) **PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër]

Nr __

DATA:

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/sherbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato te parashikuara.

- 1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.
- 1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:
- _____

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njësisive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin : < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja në Internet _____

1. Lloji i procedurës: _____

2. Numri i Referencës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Fondi limit _____

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,
neni 24, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

Etj. _____

6. Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi.