


**SPECIFIKIMET TEKNIKE**  
**“BLERJE APARATURA STOMATOLOGJIKE (UNITE DENTARE) PËR**  
**UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË”**

<b>Artikulli</b>	<b>Equipment</b>	<b>Specifikimet teknike qe duhet te plotesojne pajisjet e ofruara</b>
1	<b>Unit dentar i përbërë:</b>	
	<i>Dental Poltron</i>	<i>Poltronë Dentare</i>
	Must have motor dental chair control system with three memory	Duhet të ketë sistem të motorizuar të kontrollit të karriges dentare me 3 memorie
	Steel structure or similar metallic alloy	Strukturë çeliku ose strukturë të ngjashëm metalikë
	Moving frame mechanism must be able to set the patient in all positions	Mekanizëm lëvizës i përshtatshëm për vendosjen e pacientit në të gjitha pozicionet
	The head rest must be with adjustable positioning	Mbështetësja e kokës duhet të jetë e lëvizshme
	Electric control	Kontroll elektrik
	<i>Instrument table</i>	<i>Tavolina e instrumentave</i>
	Must be connected to the Unit with pantographic arm with control panel	Duhet të jetë e lidhur me njësinë qendrore nëpërmjet krahut "pantografik" me panel kontrollues
	2 Turbine exit (1 with OF), Turbine with air pressure max. 2.1/2.6 Bar. Velocity not less than 350.000 r/min (equipment with angel)	2 dalje Turbinash nga të cilat njëra me fibër optike, Turbinë me presion ajri max. 2.1/2.6 Bar. Shpejtësia jo më pak se 350.000 r/min ( e pajisur me angël)

	Electric Micromotor, able to perform 20.000-40.000 rpm with straight and contra-angel hanpiece with induction with wlvctronic tab.for the micromotor	Mikromotor elektrik i aftë për të performuar 20.000-40.000 rpm me kontra angël dhe pysemene me induksion me tabelë elektronike për xhirot e mikromotorrit
	built-in scaler	Kavitron i inkorporuar në poltron
	Must be ultrasonic, with angel, not less than 3 tips	Duhet të jetë ultrasonik, me kënd, jo më pak se 3 koka
	3-way syringe ( water, air, spray)	Shiringë 3 funksionale (ujë, ajër, spray)
	With control pedals ( multifunctional) to control the unit too	Me pedale kontrolli (multifunksionale) për kontrollin gjithashtu të njësisë qendrore
	x- ray film viewer	Llampë lexues film grafie
	<b>Operating light</b>	<b>Ndriçimi</b>
	Must be connected to the Unit with pantographic arm	Duhet të jetë e lidhur me njësinë qendrore nëpërmjet krahut " pantografik
	LED lamp	Llampë LED
	At least 10000-15000 lux illumination	Të paktën 10000-15000 lux ndriçim
	Minimal focusing distance 1 m	Distanca minimale e fokusimit 1 m
	<b>Spitoon</b>	<b>Pështymorja</b>
	ceramic material	Material qeramik
	Equiped with rinsing device	E pajisur me aparat shpëlarje
	Electric surgical aspirator with motor	Me aspirator kirurgjikal me motorr
	<b>Assistant table</b>	<b>Tavolina ndihmëse</b>

	Must be connected to the Unit with pantographic arm	Duhet të jetë e lidhur me njësinë qendrore nëpërmjet krahut "pantografik"
	With 2 cagnule for the simple surgical aspirator	Me dy kanjula për aspirim të thjeshtë dhe aspirim kirurgjikal
	With an exit for halogene lamp	Të ketë dalje për llampë halogjene
	Comand panel for halogene, spitoon and water glass	Panel komandues për poltronën, pështymoren dhe gotën e ujit
	<b><i>Dental Chair</i></b>	<b><i>Karrigia</i></b>
	Leather coated or imitation	E veshur me lëkurë ose imitim
	On static resistant wheels	E vendosur në rrota të palëvizshme rezistente
	Equiped with a piston to perform the movements up and down	E pajisur me piston për të kryer lëvizje poshtë e lartë

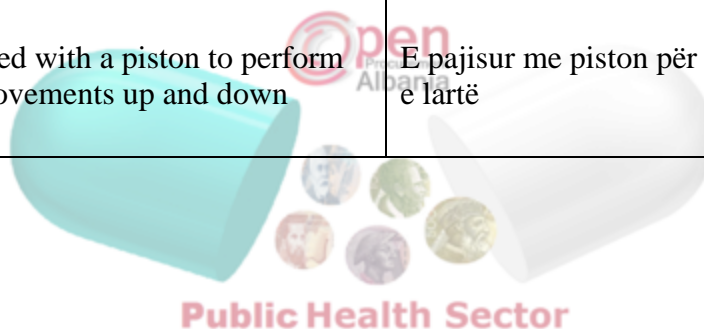

## SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

**“BLERJE APARATURA STOMATOLOGJIKE (UNITE DENTARE) PËR  
UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË”**

<b>Artikulli</b>	<b>Equipment</b>	<b>Specifikimet teknike qe duhet te plotesojne pajisjet e ofruara</b>	<b>Sasia</b>
1	<b>Unit dentar i përbërë:</b>		4
	<b><i>Dental Poltron</i></b>	<b><i>Poltronë Dentare</i></b>	
	Must have motor dental chair control system with three memory	Duhet të ketë sistem të motorizuar të kontrollit të karriges dentare me 3 memorie	
	Steel structure or similar metallic alloy	Strukturë çeliku ose strukturë të ngjashëm metalikë	
	Moving frame mechanism must be able to set the patient in all positions	Mekanizëm lëvizës i përshtatshëm për vendosjen e pacientit në të gjitha pozicionet	
	The head rest must be with adjustable positioning	Mbështetësja e kokës duhet të jetë e lëvizshme	
	Electric control	Kontroll elektrik	
	<b><i>Instrument table</i></b>	<b><i>Tavolina e instrumentave</i></b>	
	Must be connected to the Unit with pantographic arm with control panel	Duhet të jetë e lidhur me njësinë qendrore nëpërmjet krahut "pantografik" me panel kontrollues	
	2 Turbine exit (1 with OF), Turbine with air pressure max. 2.1/2.6 Bar. Velocity not less than 350.000 r/min (equipemd with angel)	2 dalje Turbinash nga të cilat njëra me fibër optike, Turbinë me presion ajri max. 2.1/2.6 Bar. Shpejtësia jo më pak se 350.000 r/min ( e pajisur me angël)	

	Electric Micromotor, able to perform 20.000-40.000 rpm with straight and contra-angel hanpiece whith induction with wlvctronic tab.for the micromotor	Mikromotor elektrik i aftë për të performuar 20.000-40.000 rpm me kontra angël dhe pysemene me induksion me tabelë elektronike për xhirot e mikromotorrit	
	built-in scaler	Kavitron i inkorporuar në poltron	
	Must be ultrasonic, with angel, not less than 3 tips	Duhet të jetë ultrasonik, me kënd, jo më pak se 3 koka	
	3-way syringe ( water, air, spray)	Shiringë 3 funksionale (ujë, ajër, spray)	
	With control pedals ( multifunctional) to control the unit too	Me pedale kontrolli (multifunksionale) për kontrollin gjithashtu të njësisë qendrore	
	x- ray film viewer	Llampë lexues film grafie	
	<b>Operating light</b>	<b>Ndriçimi</b>	
	Must be connected to the Unit with pantographic arm	Duhet të jetë e lidhur me njësinë qendrore nëpërmjet krahut " pantografik	
	LED lamp	Llampë LED	
	At least 10000-15000 lux illumination	Të paktën 10000-15000 lux ndriçim	
	Minimal focusing distance 1 m	Distanca minimale e fokusimit 1 m	
	<b>Spitoon</b>	<b>Pështymorja</b>	
	ceramic material	Material qeramik	
	Equiped with rinsing device	E pajisur me aparat shpëlarje	
	Electric surgical aspirator with motor	Me aspirator kirurgjikal me motorr	
	<b>Assistant tabble</b>	<b>Tavolina ndihmëse</b>	

	Must be connected to the Unit with pantographic arm	Duhet të jetë e lidhur me njësinë qendrore nëpërmjet krahut "pantografik"	
	With 2 cagnule for the simple surgical aspirator	Me dy kanjula për aspirim të thjeshtë dhe aspirim kirurgjikal	
	With an exit for halogene lamp	Të ketë dalje për llampë halogjene	
	Comand panel for halogene, spittoon and water glass	Panel komandues për poltronën, pështymoren dhe gotën e ujit	
	<b><i>Dental Chair</i></b>	<b><i>Karrigia</i></b>	
	Leather coated or imitation	E veshur me lëkurë ose imitim	
	On static resistant wheels	E vendosur në rrota të palëvizshme rezistente	
	Equiped with a piston to perform the movements up and down	E pajisur me piston për të kryer lëvizje poshtë e lartë	

**Afati i lëvrimit të mallit: 60 (gjashtëdhjetë) ditë nga data e nënshkrimit të kontratës**

**Public Health Sector**